ЮЛЕ

Расходные материалы для эндоурологии

ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ

ИНКОРО

Мы производим в России расходные материалы для эндоурологии

В середине 2017 года компания Инкоро, тесно сотрудничая с французскими коллегами из компании Rocamed, запустила в России на территории ОЭЗ «Технополис Москва» локализованную линию по производству изделий для эндоурологии.

Работая в соответствии с европейскими стандартами производства в течение трех лет, мы имели возможность удовлетворять потребность отечественной медицины качественной продукцией под французским брендом Rocamed.

Сегодня, накопив свой опыт, мы предлагаем вам широкую линейку продуктов под нашим собственным брендом **ЮЛЕ**.

В нее вошли наборы мочеточниковых стентов, наборы для чрескожной нефростомии, мочеточниковые катетеры и экстракторы камней.

В линейке ЮЛЕ гармонично сочетаются лучшие технологии наших партнеров из Rocamed и пожелания наших клиентов, присущие исключительно российским реалиям.

Мы используем лучшие импортные полимеры, оригинальные протоколы производства и европейские процедуры технического контроля готовых изделий, поэтому можем уверенно заявить, что качество наших продуктов, удобство их применения в клинике и комфорт для пациентов не уступают лучшим иностранным аналогам.

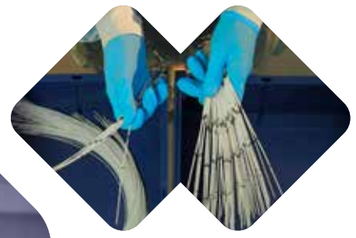

В этом каталоге:

Нефростомические наборы 2
Мочеточниковые стенты 4
Мочеточниковые катетеры 9
Экстракторы камней 10

Нефростомические наборы ЮЛЕ

Нефростомические катетеры ЮЛЕ легко и атравматично устанавливаются по многошаговой методике, а после установки — обеспечивают высокую эффективность дренирования почки и комфорт пациента.

Нефростомические катетеры ЮЛЕ выпускаются в двух вариантах — с кончиком типа «Пигтейл» и типа Малеко. Они изготовлены из синего термопластичного полиуретана французского производства.

Прочная трубка нефростомического катетера в сочетании с широким просветом обеспечивает беспрепятственный высокоэффективный дренаж почки без риска окклюзии из-за перегиба катетера.

По одному набору в упаковке.

Срок годности **3 года**

Компоненты наборов

A. Нефростомический катетер
Тип «Пигтейл»/тип Малеко. Рентгеноконтрастный термопластичный полиуретан, синий. Полый металлический (для 8 Fr) или пластиковый (для 10, 12 и 14 Fr) стилет катетера в комплекте

B. Дилататоры поэтапного расширения
Рентгеноконтрастный полимер. Встроенный адаптер Luer-Lock для возможности присоединения шприца

C. Пункционные иглы (тип «Чиба» / «Троакар»)
Двухсоставные, материал — нержавеющая сталь, размер 18G. В наборах с двумя иглами — игла «Чиба» 22G и игла «Троакар» 18G

D. Адаптер мочеприемника с краном
Универсальный коннектор для подключения мочеприемника к катетеру (во всех наборах)

E. Жесткий проводник с покрытием ПТФЭ
Мягкий атравматичный j-образный кончик. Длина 80 см или 100 см, диаметр 0.035”

Регистрационное удостоверение

РЗН 2020/11130 от 08.07.2020

Нефростомические катетеры типа **«Пигтейл»** 1 и типа **Малеко** 2

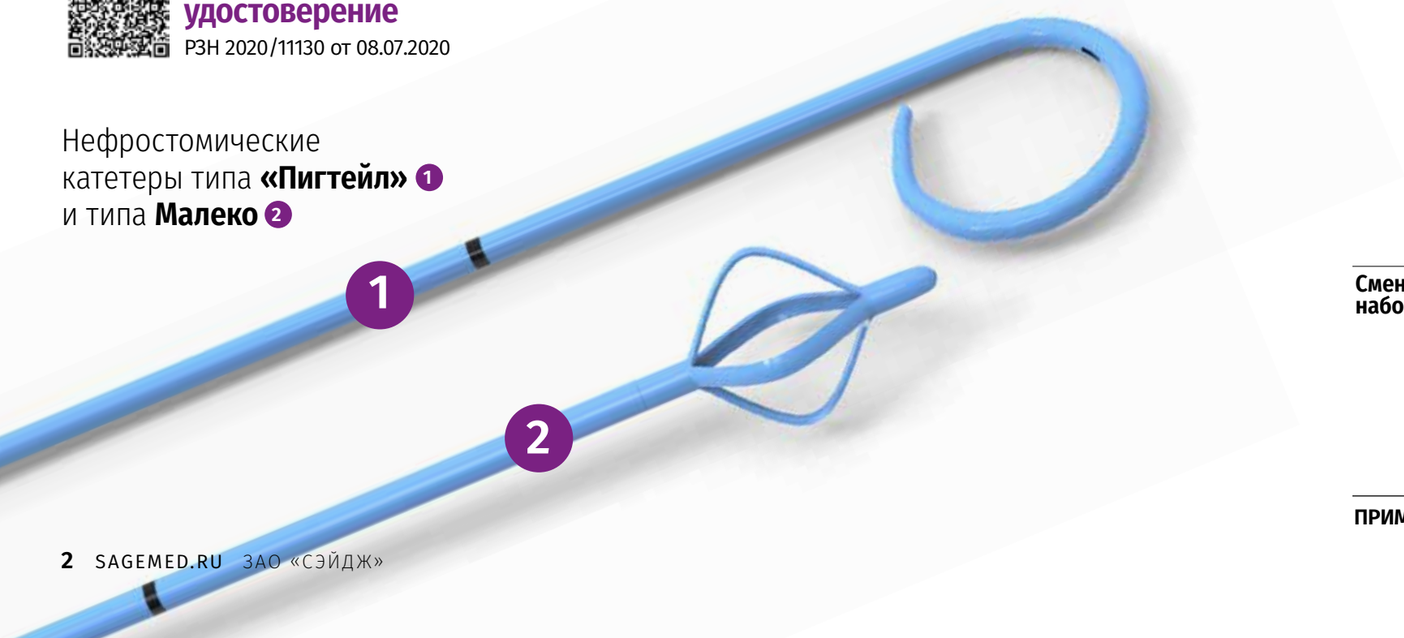

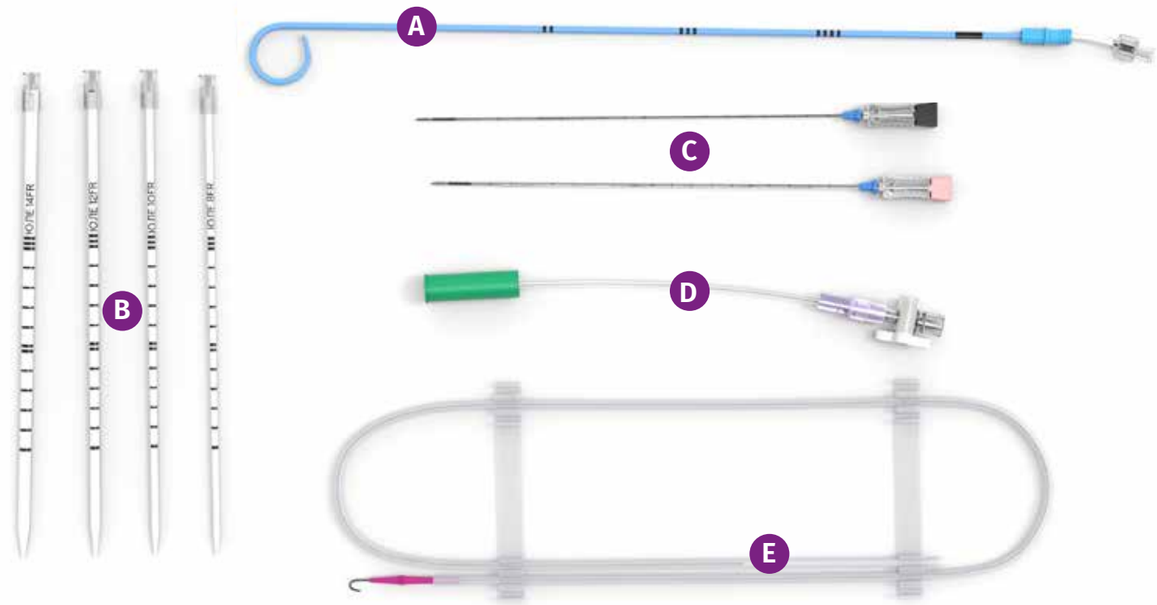

Информация для заказа: Нефростомические наборы ЮЛЕ

	Размер катетера, Fr	Струна-проводник (длина, см)	Пункционная игла Чиба (Ч) Троакар (Т)	Дилататоры				Тип нефростомического катетера	
				8 Fr	10 Fr	12 Fr	14 Fr	тип «Пигтейл» Артикул	тип Малеко Артикул
Полные пункционные наборы	**8**	80	Ч (22G) + Т (18G)	●	●	●	●	ИН НП 08 01 ЮЛ	ИН НМ 08 01 ЮЛ
	10	80	Ч (22G) + Т (18G)	●	●	●	●	ИН НП 10 01 ЮЛ	ИН НМ 10 01 ЮЛ
	12	80	Ч (22G) + Т (18G)	●	●	●	●	ИН НП 12 01 ЮЛ	ИН НМ 12 01 ЮЛ
	14	80	Ч (22G) + Т (18G)	●	●	●	●	ИН НП 14 01 ЮЛ	ИН НМ 14 01 ЮЛ
Неполные пункционные наборы	**8**	80	Ч (18G)	●	●	–	–	ИН НП 08 02 ЮЛ	ИН НМ 08 02 ЮЛ
	8	100	Ч (18G)	●	●	–	–	ИН НП 08 04 ЮЛ	ИН НМ 08 04 ЮЛ
	8	80	Т (18G)	●	●	–	–	ИН НП 08 03 ЮЛ	ИН НМ 08 03 ЮЛ
	8	100	Т (18G)	●	●	–	–	ИН НП 08 05 ЮЛ	ИН НМ 08 05 ЮЛ
	10	80	Ч (18G)	●	●	●	–	ИН НП 10 02 ЮЛ	ИН НМ 10 02 ЮЛ
	10	100	Ч (18G)	●	●	●	–	ИН НП 10 04 ЮЛ	ИН НМ 10 04 ЮЛ
	10	80	Т (18G)	●	●	●	–	ИН НП 10 03 ЮЛ	ИН НМ 10 03 ЮЛ
	10	100	Т (18G)	●	●	●	–	ИН НП 10 05 ЮЛ	ИН НМ 10 05 ЮЛ
	12	80	Ч (18G)	●	●	●	●	ИН НП 12 02 ЮЛ	ИН НМ 12 02 ЮЛ
	12	100	Ч (18G)	●	●	●	●	ИН НП 12 04 ЮЛ	ИН НМ 12 04 ЮЛ
	12	80	Т (18G)	●	●	●	●	ИН НП 12 03 ЮЛ	ИН НМ 12 03 ЮЛ
	12	100	Т (18G)	●	●	●	●	ИН НП 12 05 ЮЛ	ИН НМ 12 05 ЮЛ
	14	80	Ч (18G)	●	●	●	●	ИН НП 14 02 ЮЛ	ИН НМ 14 02 ЮЛ
	14	100	Ч (18G)	●	●	●	●	ИН НП 14 04 ЮЛ	ИН НМ 14 04 ЮЛ
	14	80	Т (18G)	●	●	●	●	ИН НП 14 03 ЮЛ	ИН НМ 14 03 ЮЛ
	14	100	Т (18G)	●	●	●	●	ИН НП 14 05 ЮЛ	ИН НМ 14 05 ЮЛ
Сменные наборы	**8**	80	–	–	–	–	–	ИН НП 08 06 ЮЛ	ИН НМ 08 06 ЮЛ
	8	100	–	–	–	–	–	ИН НП 08 07 ЮЛ	ИН НМ 08 07 ЮЛ
	10	80	–	–	–	–	–	ИН НП 10 06 ЮЛ	ИН НМ 10 06 ЮЛ
	10	100	–	–	–	–	–	ИН НП 10 07 ЮЛ	ИН НМ 10 07 ЮЛ
	12	80	–	–	–	–	–	ИН НП 12 06 ЮЛ	ИН НМ 12 06 ЮЛ
	12	100	–	–	–	–	–	ИН НП 12 07 ЮЛ	ИН НМ 12 07 ЮЛ
	8	–	–	–	–	–	–	ИН НП 08 08 ЮЛ	ИН НМ 08 08 ЮЛ
	10	–	–	–	–	–	–	ИН НП 10 08 ЮЛ	ИН НМ 10 08 ЮЛ
	12	–	–	–	–	–	–	ИН НП 12 08 ЮЛ	ИН НМ 12 08 ЮЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: Адаптер мочеприемника с краном (D) входит во все варианты нефростомических наборов ЮЛЕ

Мочеточниковые стенты ЮЛЕ

Ассортимент мочеточниковых стентов ЮЛЕ способен удовлетворить любые клинические потребности. Стенты выпускаются в различных модификациях, и каждую можно заказать в наборе, наиболее подходящем именно для вашей практики.

Мочеточниковые стенты ЮЛЕ изготовлены из жесткого или мягкого термопластичного полиуретана французского производства (поставщик — компания Rocamed France).

Технологические процессы, применяемые при обработке стентов обеспечивают их максимально атравматичное введение, возможность длительной (до 12 месяцев) имплантации и снижают риск развития осложнений.

Для кратковременного стентирования доступны варианты стентов с ретракционной нитью, позволяющей удалить стент без использования каких-либо инструментов.

Индивидуальная упаковка. По 6 упаковок в коробке.

Срок годности **3 года**

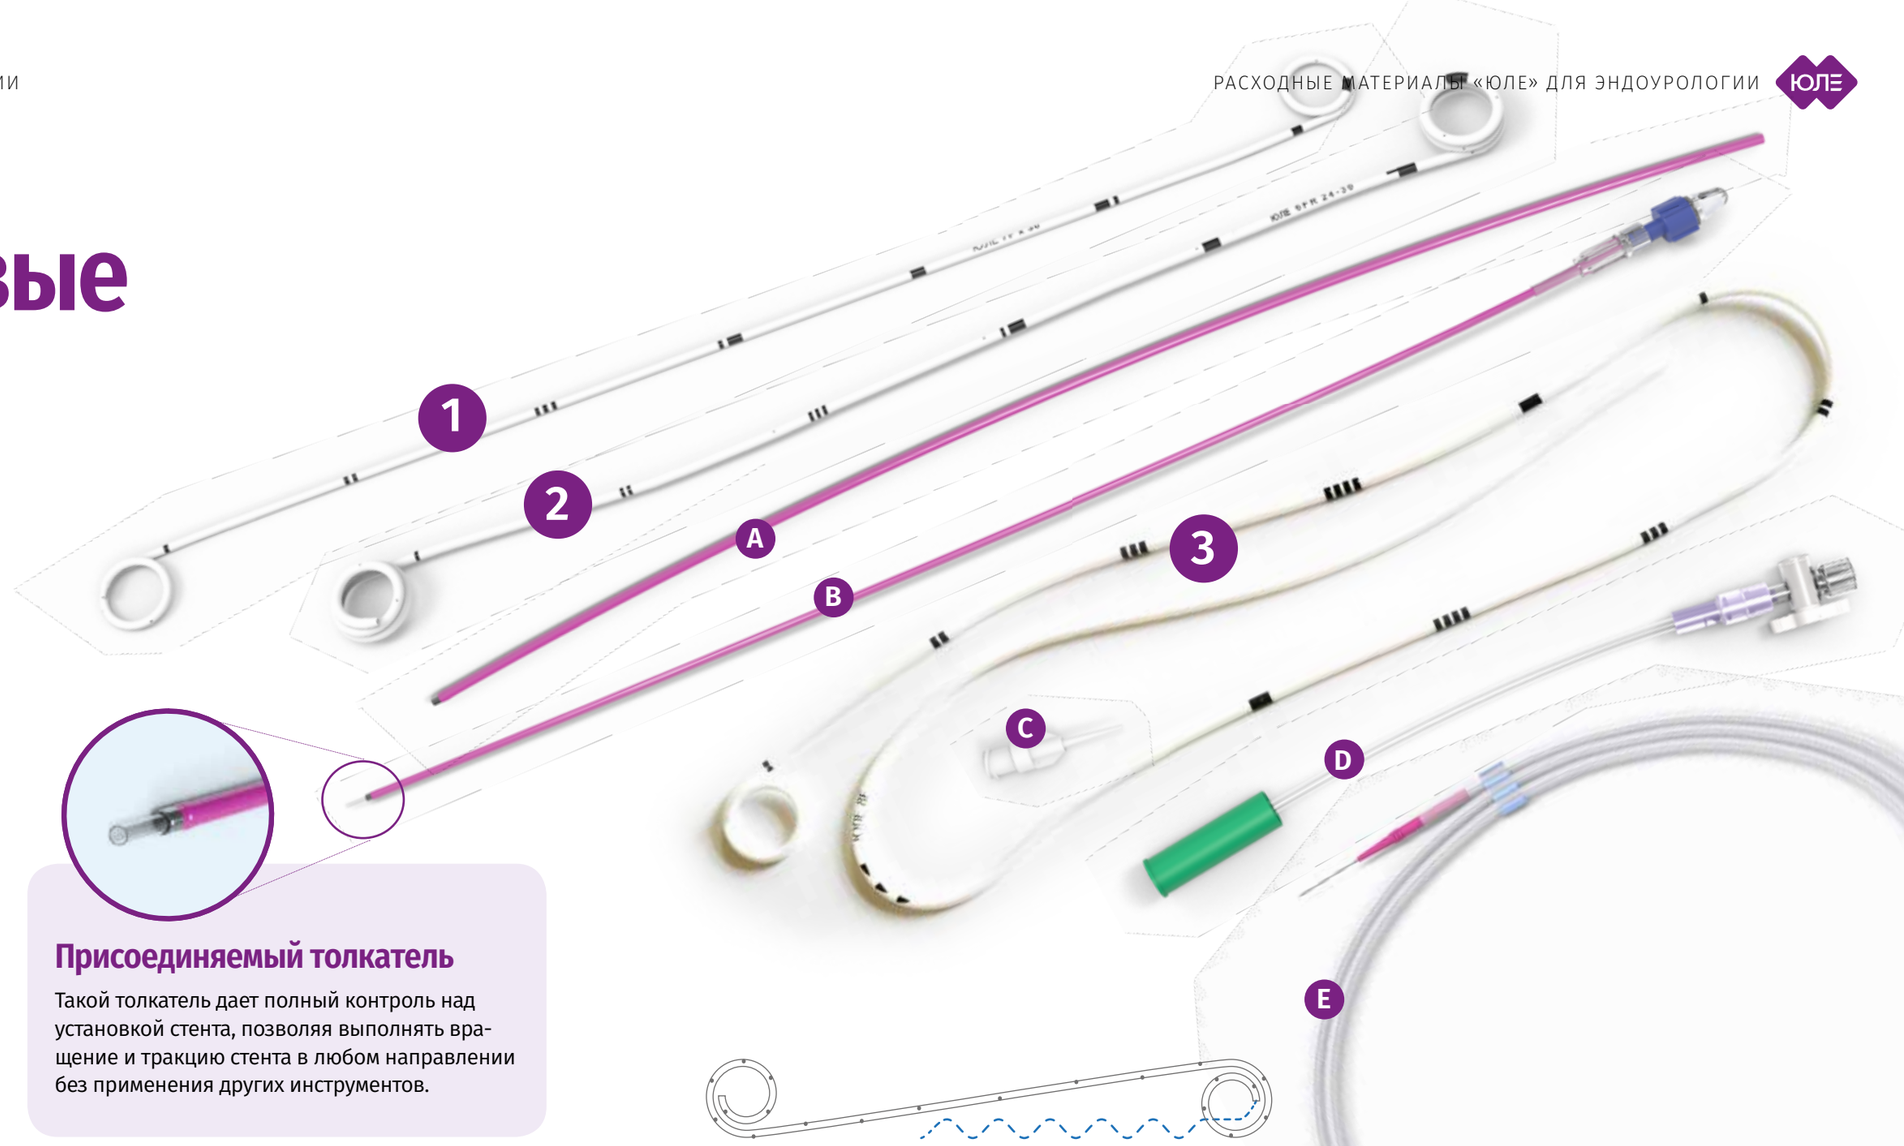

Присоединяемый толкатель

Такой толкатель дает полный контроль над установкой стента, позволяя выполнять вращение и тракцию стента в любом направлении без применения других инструментов.

Варианты стентов ЮЛЕ

Двухпетлевые мочеточниковые стенты фиксированной длины 1

В ассортименте бренда ЮЛЕ представлены стенты детских и взрослых размеров (от 3 Fr до 8 Fr), из жесткого или мягкого термочувствительного полиуретана, с гидрофильным покрытием и без него.

Дренажные отверстия расположены по всей длине стента.

Двухпетлевые мочеточниковые стенты переменной длины 2

Длину прямой части такого стента можно изменить в указанных пределах, немного развернув завитки при установке.

Это делает изделие более универсальным, позволяя подобрать оптимальную длину стента для конкретного пациента прямо во время процедуры.

Однопетлевые (наружные) мочеточниковые стенты 3

Стенты с одним завитком и прямой частью длиной 90 см, доступны в двух вариантах: с дренажными отверстиями только на «пигтейле» и с отверстиями на «пигтейле» и первых 15 см прямой части стента.

Однопетлевые стенты ЮЛЕ поставляются в наборах с Luer-адаптером и коннектором мочеприемника или отдельно без них.

Регистрационное удостоверение
РЗН 2020/11535 от 06.05.2021

Дополнительные компоненты наборов

A. Толкатель простой
С рентгеноконтрастным кольцом, длина 70 см (для стентов 4.8 Fr) или 40 см (для стентов других размеров), или два толкателя 40 и 70 см (только в наборах со стентами 4.8 Fr)

B. Толкатель присоединяемый
С рентгеноконтрастным кольцом, длина 40 см

C. Luer-адаптер однопетлевого стента

D. Коннектор мочеприемника
Только в наборах с однопетлевыми стентами

E. Струна-проводник
Прямой мягкий атравматичный наконечник, длина струны 150 см.

Варианты проводников:

Стальной с покрытием из ПТФЭ
- диаметр 0.018” *(для стентов 3 Fr)*
- диаметр 0.028” *(для стентов 4 Fr)*
- диаметр 0.035” *(для стентов ≥4.8 Fr)*

Нитиноловый с гидрофильным покрытием, диаметр 0.035” *(для стентов размером ≥4.8 Fr)*

Мочеточниковые стенты из жесткого полиуретана

			Стенты без покрытия						Стенты с гидрофильным покрытием			
			Открытый тип			Закрытый тип			Открытый тип		Закрытый тип	
			Без проводника	Стальной проводник	Нитиноловый проводник	Без проводника	Стальной проводник	Нитиноловый проводник	Стальной проводник	Нитиноловый проводник	Стальной проводник	Нитиноловый проводник
4.8 Fr	24 см	S	ИНОС0524ЮЛ*	ИНОС5524ЮЛ*	ИНОС7524ЮЛ*	ИН3С0524ЮЛ*	ИН3С5524ЮЛ*	ИН3С7524ЮЛ*	ИНОП5524ЮЛ*	ИНОП7524ЮЛ*	ИН3П5524ЮЛ*	ИН3П7524ЮЛ*
	~	S		ИНОР5524ЮЛ*	ИНОР7524ЮЛ*		ИН3Р5524ЮЛ*	ИН3Р7524ЮЛ*	ИНОМ5524ЮЛ*	ИНОМ7524ЮЛ*	ИН3М5524ЮЛ*	ИН3М7524ЮЛ*
	26 см	S	ИНОС0526ЮЛ*	ИНОС5526ЮЛ*	ИНОС7526ЮЛ*	ИН3С0526ЮЛ*	ИН3С5526ЮЛ*	ИН3С7526ЮЛ*	ИНОП5526ЮЛ*	ИНОП7526ЮЛ*	ИН3П5526ЮЛ*	ИН3П7526ЮЛ*
	~	S		ИНОР5526ЮЛ*	ИНОР7526ЮЛ*		ИН3Р5526ЮЛ*	ИН3Р7526ЮЛ*	ИНОМ5526ЮЛ*	ИНОМ7526ЮЛ*	ИН3М5526ЮЛ*	ИН3М7526ЮЛ*
	28 см	S	ИНОС0528ЮЛ*	ИНОС5528ЮЛ*	ИНОС7528ЮЛ*	ИН3С0528ЮЛ*	ИН3С5528ЮЛ*	ИН3С7528ЮЛ*	ИНОП5528ЮЛ*	ИНОП7528ЮЛ*	ИН3П5528ЮЛ*	ИН3П7528ЮЛ*
	~	S		ИНОР5528ЮЛ*	ИНОР7528ЮЛ*		ИН3Р5528ЮЛ*	ИН3Р7528ЮЛ*	ИНОМ5528ЮЛ*	ИНОМ7528ЮЛ*	ИН3М5528ЮЛ*	ИН3М7528ЮЛ*
	30 см	S	ИНОС0530ЮЛ*	ИНОС5530ЮЛ*	ИНОС7530ЮЛ*	ИН3С0530ЮЛ*	ИН3С5530ЮЛ*	ИН3С7530ЮЛ*	ИНОП5530ЮЛ*	ИНОП7530ЮЛ*	ИН3П5530ЮЛ*	ИН3П7530ЮЛ*
	~	S		ИНОР5530ЮЛ*	ИНОР7530ЮЛ*		ИН3Р5530ЮЛ*	ИН3Р7530ЮЛ*	ИНОМ5530ЮЛ*	ИНОМ7530ЮЛ*	ИН3М5530ЮЛ*	ИН3М7530ЮЛ*
6 Fr	24 см	S	ИНОС0624ЮЛ	ИНОС5624ЮЛ	ИНОС7624ЮЛ	ИН3С0624ЮЛ	ИН3С5624ЮЛ	ИН3С7624ЮЛ	ИНОП5624ЮЛ	ИНОП7624ЮЛ	ИН3П5624ЮЛ	ИН3П7624ЮЛ
		→			ИНОС9624ЮЛ			ИН3С9624ЮЛ		ИНОП9624ЮЛ		ИН3П9624ЮЛ
	~	S		ИНОР5624ЮЛ	ИНОР7624ЮЛ		ИН3Р5624ЮЛ	ИН3Р7624ЮЛ	ИНОМ5624ЮЛ	ИНОМ7624ЮЛ	ИН3М5624ЮЛ	ИН3М7624ЮЛ
	~	→			ИНОР9624ЮЛ			ИН3Р9624ЮЛ		ИНОМ9624ЮЛ		ИН3М9624ЮЛ
	26 см	S	ИНОС0626ЮЛ	ИНОС5626ЮЛ	ИНОС7626ЮЛ	ИН3С0626ЮЛ	ИН3С5626ЮЛ	ИН3С7626ЮЛ	ИНОП5626ЮЛ	ИНОП7626ЮЛ	ИН3П5626ЮЛ	ИН3П7626ЮЛ
		→			ИНОС9626ЮЛ			ИН3С9626ЮЛ		ИНОП9626ЮЛ		ИН3П9626ЮЛ
	~	S		ИНОР5626ЮЛ	ИНОР7626ЮЛ		ИН3Р5626ЮЛ	ИН3Р7626ЮЛ	ИНОМ5626ЮЛ	ИНОМ7626ЮЛ	ИН3М5626ЮЛ	ИН3М7626ЮЛ
	~	→			ИНОР9626ЮЛ			ИН3Р9626ЮЛ		ИНОМ9626ЮЛ		ИН3М9626ЮЛ
	28 см	S	ИНОС0628ЮЛ	ИНОС5628ЮЛ	ИНОС7628ЮЛ	ИН3С0628ЮЛ	ИН3С5628ЮЛ	ИН3С7628ЮЛ	ИНОП5628ЮЛ	ИНОП7628ЮЛ	ИН3П5628ЮЛ	ИН3П7628ЮЛ
		→			ИНОС9628ЮЛ			ИН3С9628ЮЛ		ИНОП9628ЮЛ		ИН3П9628ЮЛ
	~	S		ИНОР5628ЮЛ	ИНОР7628ЮЛ		ИН3Р5628ЮЛ	ИН3Р7628ЮЛ	ИНОМ5628ЮЛ	ИНОМ7628ЮЛ	ИН3М5628ЮЛ	ИН3М7628ЮЛ
	~	→			ИНОР9628ЮЛ			ИН3Р9628ЮЛ		ИНОМ9628ЮЛ		ИН3М9628ЮЛ
	30 см	S	ИНОС0630ЮЛ	ИНОС5630ЮЛ	ИНОС7630ЮЛ	ИН3С0630ЮЛ	ИН3С5630ЮЛ	ИН3С7630ЮЛ	ИНОП5630ЮЛ	ИНОП7630ЮЛ	ИН3П5630ЮЛ	ИН3П7630ЮЛ
		→			ИНОС9630ЮЛ			ИН3С9630ЮЛ		ИНОП9630ЮЛ		ИН3П9630ЮЛ
	~	S		ИНОР5630ЮЛ	ИНОР7630ЮЛ		ИН3Р5630ЮЛ	ИН3Р7630ЮЛ	ИНОМ5630ЮЛ	ИНОМ7630ЮЛ	ИН3М5630ЮЛ	ИН3М7630ЮЛ
	~	→			ИНОР9630ЮЛ			ИН3Р9630ЮЛ		ИНОМ9630ЮЛ		ИН3М9630ЮЛ
7 Fr	24 см	S	ИНОС0724ЮЛ	ИНОС5724ЮЛ	ИНОС7724ЮЛ	ИН3С0724ЮЛ	ИН3С5724ЮЛ	ИН3С7724ЮЛ	ИНОП5724ЮЛ	ИНОП7724ЮЛ	ИН3П5724ЮЛ	ИН3П7724ЮЛ
		→			ИНОС9724ЮЛ			ИН3С9724ЮЛ		ИНОП9724ЮЛ		ИН3П9724ЮЛ
	~	S		ИНОР5724ЮЛ	ИНОР7724ЮЛ		ИН3Р5724ЮЛ	ИН3Р7724ЮЛ	ИНОМ5724ЮЛ	ИНОМ7724ЮЛ	ИН3М5724ЮЛ	ИН3М7724ЮЛ
	~	→			ИНОР9724ЮЛ			ИН3Р9724ЮЛ		ИНОМ9724ЮЛ		ИН3М9724ЮЛ
	26 см	S	ИНОС0726ЮЛ	ИНОС5726ЮЛ	ИНОС7726ЮЛ	ИН3С0726ЮЛ	ИН3С5726ЮЛ	ИН3С7726ЮЛ	ИНОП5726ЮЛ	ИНОП7726ЮЛ	ИН3П5726ЮЛ	ИН3П7726ЮЛ
		→			ИНОС9726ЮЛ			ИН3С9726ЮЛ		ИНОП9726ЮЛ		ИН3П9726ЮЛ
	~	S		ИНОР5726ЮЛ	ИНОР7726ЮЛ		ИН3Р5726ЮЛ	ИН3Р7726ЮЛ	ИНОМ5726ЮЛ	ИНОМ7726ЮЛ	ИН3М5726ЮЛ	ИН3М7726ЮЛ
	~	→			ИНОР9726ЮЛ			ИН3Р9726ЮЛ		ИНОМ9726ЮЛ		ИН3М9726ЮЛ
	28 см	S	ИНОС0728ЮЛ	ИНОС5728ЮЛ	ИНОС7728ЮЛ	ИН3С0728ЮЛ	ИН3С5728ЮЛ	ИН3С7728ЮЛ	ИНОП5728ЮЛ	ИНОП7728ЮЛ	ИН3П5728ЮЛ	ИН3П7728ЮЛ
		→			ИНОС9728ЮЛ			ИН3С9728ЮЛ		ИНОП9728ЮЛ		ИН3П9728ЮЛ
	~	S		ИНОР5728ЮЛ	ИНОР7728ЮЛ		ИН3Р5728ЮЛ	ИН3Р7728ЮЛ	ИНОМ5728ЮЛ	ИНОМ7728ЮЛ	ИН3М5728ЮЛ	ИН3М7728ЮЛ
	~	→			ИНОР9728ЮЛ			ИН3Р9728ЮЛ		ИНОМ9728ЮЛ		ИН3М9728ЮЛ
	30 см	S	ИНОС0730ЮЛ	ИНОС5730ЮЛ	ИНОС7730ЮЛ	ИН3С0730ЮЛ	ИН3С5730ЮЛ	ИН3С7730ЮЛ	ИНОП5730ЮЛ	ИНОП7730ЮЛ	ИН3П5730ЮЛ	ИН3П7730ЮЛ
		→			ИНОС9730ЮЛ			ИН3С9730ЮЛ		ИНОП9730ЮЛ		ИН3П9730ЮЛ
	~	S		ИНОР5730ЮЛ	ИНОР7730ЮЛ		ИН3Р5730ЮЛ	ИН3Р7730ЮЛ	ИНОМ5730ЮЛ	ИНОМ7730ЮЛ	ИН3М5730ЮЛ	ИН3М7730ЮЛ
	~	→			ИНОР9730ЮЛ			ИН3Р9730ЮЛ		ИНОМ9730ЮЛ		ИН3М9730ЮЛ

Условные обозначения

8 Fr — Размер стента

24 см — Длина стента

S — Стенты в наборе с простым толкателем

→ — Стенты в наборе с присоединяемым толкателем

~ — Стент с ретракционной нитью

* Обратите внимание:

Для артикулов, помеченных «звездочкой» (*), доступна комплектация с двумя простыми толкателями (40 см и 70 см). Чтобы заказать набор с двумя толкателями, к артикулу нужно прибавить суффикс «-2», например:

ИН3С0526ЮЛ → ИН3С0526ЮЛ**-2**

Информация для заказа: Двухпетлевые мочеточниковые стенты ЮЛЕ

для взрослых пациентов

Мочеточниковые стенты из мягкого полиуретана

			Стенты без покрытия						Стенты с гидрофильным покрытием			
			Открытый тип			Закрытый тип			Открытый тип		Закрытый тип	
			Без проводника	Стальной проводник	Нитиноловый проводник	Без проводника	Стальной проводник	Нитиноловый проводник	Стальной проводник	Нитиноловый проводник	Стальной проводник	Нитиноловый проводник
			ИНОЛ0624ЮЛ	ИНОЛ5624ЮЛ	ИНОЛ7624ЮЛ	ИН3Л0624ЮЛ	ИН3Л5624ЮЛ	ИН3Л7624ЮЛ	ИНОД5624ЮЛ	ИНОД7624ЮЛ	ИН3Д5624ЮЛ	ИН3Д7624ЮЛ
					ИНОЛ9624ЮЛ			ИН3Л9624ЮЛ		ИНОД9624ЮЛ		ИН3Д9624ЮЛ
				ИНОК5624ЮЛ	ИНОК7624ЮЛ		ИН3К5624ЮЛ	ИН3К7624ЮЛ	ИНОВ5624ЮЛ	ИНОВ7624ЮЛ	ИН3В5624ЮЛ	ИН3В7624ЮЛ
					ИНОК9624ЮЛ			ИН3К9624ЮЛ		ИНОВ9624ЮЛ		ИН3В9624ЮЛ
			ИНОЛ0626ЮЛ	ИНОЛ5626ЮЛ	ИНОЛ7626ЮЛ	ИН3Л0626ЮЛ	ИН3Л5626ЮЛ	ИН3Л7626ЮЛ	ИНОД5626ЮЛ	ИНОД7626ЮЛ	ИН3Д5626ЮЛ	ИН3Д7626ЮЛ
					ИНОЛ9626ЮЛ			ИН3Л9626ЮЛ		ИНОД9626ЮЛ		ИН3Д9626ЮЛ
				ИНОК5626ЮЛ	ИНОК7626ЮЛ		ИН3К5626ЮЛ	ИН3К7626ЮЛ	ИНОВ5626ЮЛ	ИНОВ7626ЮЛ	ИН3В5626ЮЛ	ИН3В7626ЮЛ
					ИНОК9626ЮЛ			ИН3К9626ЮЛ		ИНОВ9626ЮЛ		ИН3В9626ЮЛ
			ИНОЛ0628ЮЛ	ИНОЛ5628ЮЛ	ИНОЛ7628ЮЛ	ИН3Л0628ЮЛ	ИН3Л5628ЮЛ	ИН3Л7628ЮЛ	ИНОД5628ЮЛ	ИНОД7628ЮЛ	ИН3Д5628ЮЛ	ИН3Д7628ЮЛ
					ИНОЛ9628ЮЛ			ИН3Л9628ЮЛ		ИНОД9628ЮЛ		ИН3Д9628ЮЛ
				ИНОК5628ЮЛ	ИНОК7628ЮЛ		ИН3К5628ЮЛ	ИН3К7628ЮЛ	ИНОВ5628ЮЛ	ИНОВ7628ЮЛ	ИН3В5628ЮЛ	ИН3В7628ЮЛ
					ИНОК9628ЮЛ			ИН3К9628ЮЛ		ИНОВ9628ЮЛ		ИН3В9628ЮЛ
			ИНОЛ0630ЮЛ	ИНОЛ5630ЮЛ	ИНОЛ7630ЮЛ	ИН3Л0630ЮЛ	ИН3Л5630ЮЛ	ИН3Л7630ЮЛ	ИНОД5630ЮЛ	ИНОД7630ЮЛ	ИН3Д5630ЮЛ	ИН3Д7630ЮЛ
					ИНОЛ9630ЮЛ			ИН3Л9630ЮЛ		ИНОД9630ЮЛ		ИН3Д9630ЮЛ
				ИНОК5630ЮЛ	ИНОК7630ЮЛ		ИН3К5630ЮЛ	ИН3К7630ЮЛ	ИНОВ5630ЮЛ	ИНОВ7630ЮЛ	ИН3В5630ЮЛ	ИН3В7630ЮЛ
					ИНОК9630ЮЛ			ИН3К9630ЮЛ		ИНОВ9630ЮЛ		ИН3В9630ЮЛ
			ИНОЛ0724ЮЛ	ИНОЛ5724ЮЛ	ИНОЛ7724ЮЛ	ИН3Л0724ЮЛ	ИН3Л5724ЮЛ	ИН3Л7724ЮЛ	ИНОД5724ЮЛ	ИНОД7724ЮЛ	ИН3Д5724ЮЛ	ИН3Д7724ЮЛ
					ИНОЛ9724ЮЛ			ИН3Л9724ЮЛ		ИНОД9724ЮЛ		ИН3Д9724ЮЛ
				ИНОК5724ЮЛ	ИНОК7724ЮЛ		ИН3К5724ЮЛ	ИН3К7724ЮЛ	ИНОВ5724ЮЛ	ИНОВ7724ЮЛ	ИН3В5724ЮЛ	ИН3В7724ЮЛ
					ИНОК9724ЮЛ			ИН3К9724ЮЛ		ИНОВ9724ЮЛ		ИН3В9724ЮЛ
			ИНОЛ0726ЮЛ	ИНОЛ5726ЮЛ	ИНОЛ7726ЮЛ	ИН3Л0726ЮЛ	ИН3Л5726ЮЛ	ИН3Л7726ЮЛ	ИНОД5726ЮЛ	ИНОД7726ЮЛ	ИН3Д5726ЮЛ	ИН3Д7726ЮЛ
					ИНОЛ9726ЮЛ			ИН3Л9726ЮЛ		ИНОД9726ЮЛ		ИН3Д9726ЮЛ
				ИНОК5726ЮЛ	ИНОК7726ЮЛ		ИН3К5726ЮЛ	ИН3К7726ЮЛ	ИНОВ5726ЮЛ	ИНОВ7726ЮЛ	ИН3В5726ЮЛ	ИН3В7726ЮЛ
					ИНОК9726ЮЛ			ИН3К9726ЮЛ		ИНОВ9726ЮЛ		ИН3В9726ЮЛ
			ИНОЛ0728ЮЛ	ИНОЛ5728ЮЛ	ИНОЛ7728ЮЛ	ИН3Л0728ЮЛ	ИН3Л5728ЮЛ	ИН3Л7728ЮЛ	ИНОД5728ЮЛ	ИНОД7728ЮЛ	ИН3Д5728ЮЛ	ИН3Д7728ЮЛ
					ИНОЛ9728ЮЛ			ИН3Л9728ЮЛ		ИНОД9728ЮЛ		ИН3Д9728ЮЛ
				ИНОК5728ЮЛ	ИНОК7728ЮЛ		ИН3К5728ЮЛ	ИН3К7728ЮЛ	ИНОВ5728ЮЛ	ИНОВ7728ЮЛ	ИН3В5728ЮЛ	ИН3В7728ЮЛ
					ИНОК9728ЮЛ			ИН3К9728ЮЛ		ИНОВ9728ЮЛ		ИН3В9728ЮЛ
			ИНОЛ0730ЮЛ	ИНОЛ5730ЮЛ	ИНОЛ7730ЮЛ	ИН3Л0730ЮЛ	ИН3Л5730ЮЛ	ИН3Л7730ЮЛ	ИНОД5730ЮЛ	ИНОД7730ЮЛ	ИН3Д5730ЮЛ	ИН3Д7730ЮЛ
					ИНОЛ9730ЮЛ			ИН3Л9730ЮЛ		ИНОД9730ЮЛ		ИН3Д9730ЮЛ
				ИНОК5730ЮЛ	ИНОК7730ЮЛ		ИН3К5730ЮЛ	ИН3К7730ЮЛ	ИНОВ5730ЮЛ	ИНОВ7730ЮЛ	ИН3В5730ЮЛ	ИН3В7730ЮЛ
					ИНОК9730ЮЛ			ИН3К9730ЮЛ		ИНОВ9730ЮЛ		ИН3В9730ЮЛ
8 Fr	24 см	S	ИНОЛ0824ЮЛ	ИНОЛ5824ЮЛ	ИНОЛ7824ЮЛ	ИН3Л0824ЮЛ	ИН3Л5824ЮЛ	ИН3Л7824ЮЛ	ИНОД5824ЮЛ	ИНОД7824ЮЛ	ИН3Д5824ЮЛ	ИН3Д7824ЮЛ
		→			ИНОЛ9824ЮЛ			ИН3Л9824ЮЛ		ИНОД9824ЮЛ		ИН3Д9824ЮЛ
	~	S		ИНОК5824ЮЛ	ИНОК7824ЮЛ		ИН3К5824ЮЛ	ИН3К7824ЮЛ	ИНОВ5824ЮЛ	ИНОВ7824ЮЛ	ИН3В5824ЮЛ	ИН3В7824ЮЛ
	~	→			ИНОК9824ЮЛ			ИН3К9824ЮЛ		ИНОВ9824ЮЛ		ИН3В9824ЮЛ
	26 см	S	ИНОЛ0826ЮЛ	ИНОЛ5826ЮЛ	ИНОЛ7826ЮЛ	ИН3Л0826ЮЛ	ИН3Л5826ЮЛ	ИН3Л7826ЮЛ	ИНОД5826ЮЛ	ИНОД7826ЮЛ	ИН3Д5826ЮЛ	ИН3Д7826ЮЛ
		→			ИНОЛ9826ЮЛ			ИН3Л9826ЮЛ		ИНОД9826ЮЛ		ИН3Д9826ЮЛ
	~	S		ИНОК5826ЮЛ	ИНОК7826ЮЛ		ИН3К5826ЮЛ	ИН3К7826ЮЛ	ИНОВ5826ЮЛ	ИНОВ7826ЮЛ	ИН3В5826ЮЛ	ИН3В7826ЮЛ
	~	→			ИНОК9826ЮЛ			ИН3К9826ЮЛ		ИНОВ9826ЮЛ		ИН3В9826ЮЛ
	28 см	S	ИНОЛ0828ЮЛ	ИНОЛ5828ЮЛ	ИНОЛ7828ЮЛ	ИН3Л0828ЮЛ	ИН3Л5828ЮЛ	ИН3Л7828ЮЛ	ИНОД5828ЮЛ	ИНОД7828ЮЛ	ИН3Д5828ЮЛ	ИН3Д7828ЮЛ
		→			ИНОЛ9828ЮЛ			ИН3Л9828ЮЛ		ИНОД9828ЮЛ		ИН3Д9828ЮЛ
	~	S		ИНОК5828ЮЛ	ИНОК7828ЮЛ		ИН3К5828ЮЛ	ИН3К7828ЮЛ	ИНОВ5828ЮЛ	ИНОВ7828ЮЛ	ИН3В5828ЮЛ	ИН3В7828ЮЛ
	~	→			ИНОК9828ЮЛ			ИН3К9828ЮЛ		ИНОВ9828ЮЛ		ИН3В9828ЮЛ
	30 см	S	ИНОЛ0830ЮЛ	ИНОЛ5830ЮЛ	ИНОЛ7830ЮЛ	ИН3Л0830ЮЛ	ИН3Л5830ЮЛ	ИН3Л7830ЮЛ	ИНОД5830ЮЛ	ИНОД7830ЮЛ	ИН3Д5830ЮЛ	ИН3Д7830ЮЛ
		→			ИНОЛ9830ЮЛ			ИН3Л9830ЮЛ		ИНОД9830ЮЛ		ИН3Д9830ЮЛ
	~	S		ИНОК5830ЮЛ	ИНОК7830ЮЛ		ИН3К5830ЮЛ	ИН3К7830ЮЛ	ИНОВ5830ЮЛ	ИНОВ7830ЮЛ	ИН3В5830ЮЛ	ИН3В7830ЮЛ
	~	→			ИНОК9830ЮЛ			ИН3К9830ЮЛ		ИНОВ9830ЮЛ		ИН3В9830ЮЛ

Информация для заказа:

Двухпетлевые мочеточниковые стенты ЮЛЕ для педиатрических пациентов

Стенты открытого или закрытого типа без гидрофильного покрытия, из мягкого или жесткого полиуретана, с ретракционной нитью, в наборе со стальным проводником с ПТФЭ-покрытием (длина 150 см; диаметр: 0.018” для стентов 3 Fr; 0.028” — для стентов 4 Fr; диаметр 0.035” для стентов 4.8 — 6 Fr) и простым (S) толкателем с рентгеноконтрастным кольцом (длина: 40 см для стентов 3 Fr, 4 Fr, 6 Fr и 7 Fr; 70 см — для стентов 4.8 Fr)

		Жесткий полиуретан Без гидроф. прокрытия		Мягкий полиуретан Без гидроф. покрытия	
		Открытый тип	Закрытый тип	Открытый тип	Закрытый тип
		Стальной проводник	Стальной проводник	Стальной проводник	Стальной проводник
3 Fr	12 см ~ S	ИНОС5312ЮЛ	ИНЗС5312ЮЛ		
	15 см ~ S	ИНОС5315ЮЛ	ИНЗС5315ЮЛ		
	18 см ~ S	ИНОС5318ЮЛ	ИНЗС5318ЮЛ		
	20 см ~ S	ИНОС5320ЮЛ	ИНЗС5320ЮЛ		
	22 см ~ S	ИНОС5322ЮЛ	ИНЗС5322ЮЛ		
4 Fr	12 см ~ S	ИНОС5412ЮЛ	ИНЗС5412ЮЛ		
	15 см ~ S	ИНОС5415ЮЛ	ИНЗС5415ЮЛ		
	18 см ~ S	ИНОС5418ЮЛ	ИНЗС5418ЮЛ		
	20 см ~ S	ИНОС5420ЮЛ	ИНЗС5420ЮЛ		
	22 см ~ S	ИНОС5422ЮЛ	ИНЗС5422ЮЛ		
4.8 Fr	10 см ~ S	ИНОС5510ЮЛ	ИНЗС5510ЮЛ		
	12 см ~ S	ИНОС5512ЮЛ	ИНЗС5512ЮЛ		
	15 см ~ S	ИНОС5515ЮЛ	ИНЗС5515ЮЛ		
	18 см ~ S	ИНОС5518ЮЛ	ИНЗС5518ЮЛ		
	20 см ~ S	ИНОС5520ЮЛ	ИНЗС5520ЮЛ		
	22 см ~ S	ИНОС5522ЮЛ	ИНЗС5522ЮЛ		
6 Fr	12 см ~ S	ИНОС5612ЮЛ	ИНЗС5612ЮЛ	ИНОЛ5612ЮЛ	ИНЗЛ5612ЮЛ
	22 см ~ S		ИНЗС5622ЮЛ	ИНОЛ5622ЮЛ	ИНЗЛ5622ЮЛ
7 Fr	12 см ~ S	ИНОС5712ЮЛ	ИНЗС5712ЮЛ	ИНОЛ5712ЮЛ	ИНЗЛ5712ЮЛ
	22 см ~ S		ИНЗС5722ЮЛ	ИНОЛ5722ЮЛ	ИНЗЛ5722ЮЛ

Условные обозначения:
~ Стент с ретракционной нитью
S Набор с простым толкателем

Двухпетлевые мочеточниковые стенты ЮЛЕ переменной длины

Стенты переменной длины («мультидлина») открытого типа с гидрофильным покрытием, из мягкого или жесткого полиуретана, с ретракционной нитью (~) или без нее, в наборе с жестким нитиноловым проводником с гидрофильным покрытием или стальным проводником с ПТФЭ-покрытием (длина проводника 150 см; диаметр: 0.035”), простым (S) толкателем с рентгеноконтрастным кольцом (длина: 40 см — для стентов 6 Fr и 7 Fr; 70 см — для стентов 4.8 Fr) или с присоединяемым (⇥) толкателем с рентгеноконтрастным кольцом (длина 40 см).

		Жесткий полиуретан Гидрофильное покрытие Открытый тип		Мягкий полиуретан Гидрофильное покрытие Открытый тип	
		Стальной проводник	Нитиноловый проводник	Стальной проводник	Нитиноловый проводник
4.8 Fr	22-32 см S	ИНСВ5532ЮЛ	ИНСВ7532ЮЛ		
	~ S	ИНСБ5532ЮЛ	ИНСБ7532ЮЛ		
	24-30 см S	ИНСВ5530ЮЛ	ИНСВ7530ЮЛ		
	~ S	ИНСБ5530ЮЛ	ИНСБ7530ЮЛ		
6 Fr	22-32 см S			ИНСВ5632ЮЛ	ИНСВ7632ЮЛ
	~ S			ИНСБ5632ЮЛ	ИНСБ7632ЮЛ
	⇥			ИНСВ3632ЮЛ	ИНСВ9632ЮЛ
	~ ⇥			ИНСБ3632ЮЛ	ИНСБ9632ЮЛ
	24-30 см S			ИНСВ5630ЮЛ	ИНСВ7630ЮЛ
	~ S			ИНСБ5630ЮЛ	ИНСБ7630ЮЛ
	⇥			ИНСВ3630ЮЛ	ИНСВ9630ЮЛ
	~ ⇥			ИНСБ3630ЮЛ	ИНСБ9630ЮЛ
7 Fr	22-32 см S			ИНСВ5732ЮЛ	ИНСВ7732ЮЛ
	~ S			ИНСБ5732ЮЛ	ИНСБ7732ЮЛ
	⇥			ИНСВ3732ЮЛ	ИНСВ9732ЮЛ
	~ ⇥			ИНСБ3732ЮЛ	ИНСБ9732ЮЛ
	24-30 см S			ИНСВ5730ЮЛ	ИНСВ7730ЮЛ
	~ S			ИНСБ5730ЮЛ	ИНСБ7730ЮЛ
	⇥			ИНСВ3730ЮЛ	ИНСВ9730ЮЛ
	~ ⇥			ИНСБ3730ЮЛ	ИНСБ9730ЮЛ

Условные обозначения:
~ Стент с ретракционной нитью
S Набор с простым толкателем
⇥ Набор с присоединяемым толкателем

Однопетлевые (наружные) мочеточниковые стенты ЮЛЕ

Длина 90 см, в наборе с жестким нитиноловым проводником с гидрофильным покрытием или стальным проводником с ПТФЭ-покрытием (длина проводника 150 см; диаметр: 0.035”), а также с Luer-адаптером и коннектором для мочеприемника или без них.

		Дренажные отверстия только на пигтейле		Дренажные отверстия на пигтейле и первых 15 см	
	Luer-адаптер, коннектор	Стальной проводник	Нитиноловый проводник	Стальной проводник	Нитиноловый проводник
6 Fr	да	ИНСД5690ЮЛ	ИНСД7690ЮЛ	ИНСЛ5690ЮЛ	ИНСЛ7690ЮЛ
	нет	ИНСК5690ЮЛ	ИНСК7690ЮЛ	ИНСР5690ЮЛ	ИНСР7690ЮЛ
7 Fr	да	ИНСД5790ЮЛ	ИНСД7790ЮЛ	ИНСЛ5790ЮЛ	ИНСЛ7790ЮЛ
	нет	ИНСК5790ЮЛ	ИНСК7790ЮЛ	ИНСР5790ЮЛ	ИНСР7790ЮЛ
8 Fr	да	ИНСД5890ЮЛ	ИНСД7890ЮЛ		
	нет	ИНСК5890ЮЛ	ИНСК7890ЮЛ		

Мочеточниковые катетеры ЮЛЕ

Мочеточниковые катетеры ЮЛЕ изготовлены из рентгеноконтрастного термопластичного полиуретана оптимальной жесткости.

Они предназначены для интраоперационного контрастирования, промывания и кратковременного (до 14 суток) дренирования верхних отделов мочевыводящих путей.

Индивидуальная упаковка. По 10 упаковок в коробке.

Срок годности **3 года**

Мочеточниковые катетеры A
(сверху вниз):
Прямой (с отверстиями)
Прямой (без отверстий)
Изогнутый (без отверстий)

Luer-адаптер катетера B

Компоненты наборов

A. Мочеточниковый катетер
Длина 74 см, размер 4 Fr ... 8 Fr, с прямым или изогнутым дистальным наконечником открытого типа (с боковыми отверстиями или без них) или закрытого типа (с боковыми отверстиями), с гидрофильным покрытием или без него

Стилет катетера *(не показан на рисунке)*
Изготовлен из полиамида, длина 74 см, стилет предварительно установлен в катетере

B. Luer-адаптер катетера
Для соединения с мочеприемником

Информация для заказа: Мочеточниковые катетеры ЮЛЕ

		Прямой наконечник катетера			Изогнутый наконечник катетера		
		Открытый тип		Закрытый тип	Открытый тип		Закрытый тип
		без отверстий	с отверстиями	с отверстиями	без отверстий	с отверстиями	с отверстиями
Без гидрофильного покрытия	4 Fr	ИНКП4000ЮЛ	ИНКП4010ЮЛ	ИНКП4011ЮЛ	ИНКИ4000ЮЛ	ИНКИ4010ЮЛ	ИНКИ4011ЮЛ
	5 Fr	ИНКП5000ЮЛ	ИНКП5010ЮЛ	ИНКП5011ЮЛ	ИНКИ5000ЮЛ	ИНКИ5010ЮЛ	ИНКИ5011ЮЛ
	6 Fr	ИНКП6000ЮЛ	ИНКП6010ЮЛ	ИНКП6011ЮЛ	ИНКИ6000ЮЛ	ИНКИ6010ЮЛ	ИНКИ6011ЮЛ
	7 Fr	ИНКП7000ЮЛ	ИНКП7010ЮЛ	ИНКП7011ЮЛ	ИНКИ7000ЮЛ	ИНКИ7010ЮЛ	ИНКИ7011ЮЛ
	8 Fr	ИНКП8000ЮЛ	ИНКП8010ЮЛ	ИНКП8011ЮЛ	ИНКИ8000ЮЛ	ИНКИ8010ЮЛ	ИНКИ8011ЮЛ
С гидрофильным покрытием	4 Fr	ИНКП4100ЮЛ	ИНКП4110ЮЛ	ИНКП4111ЮЛ	ИНКИ4100ЮЛ	ИНКИ4110ЮЛ	ИНКИ4111ЮЛ
	5 Fr	ИНКП5100ЮЛ	ИНКП5110ЮЛ	ИНКП5111ЮЛ	ИНКИ5100ЮЛ	ИНКИ5110ЮЛ	ИНКИ5111ЮЛ
	6 Fr	ИНКП6100ЮЛ	ИНКП6110ЮЛ	ИНКП6111ЮЛ	ИНКИ6100ЮЛ	ИНКИ6110ЮЛ	ИНКИ6111ЮЛ
	7 Fr	ИНКП7100ЮЛ	ИНКП7110ЮЛ	ИНКП7111ЮЛ	ИНКИ7100ЮЛ	ИНКИ7110ЮЛ	ИНКИ7111ЮЛ
	8 Fr	ИНКП8100ЮЛ	ИНКП8110ЮЛ	ИНКП8111ЮЛ	ИНКИ8100ЮЛ	ИНКИ8110ЮЛ	ИНКИ8111ЮЛ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ЮЛЕ» ДЛЯ ЭНДОУРОЛОГИИ

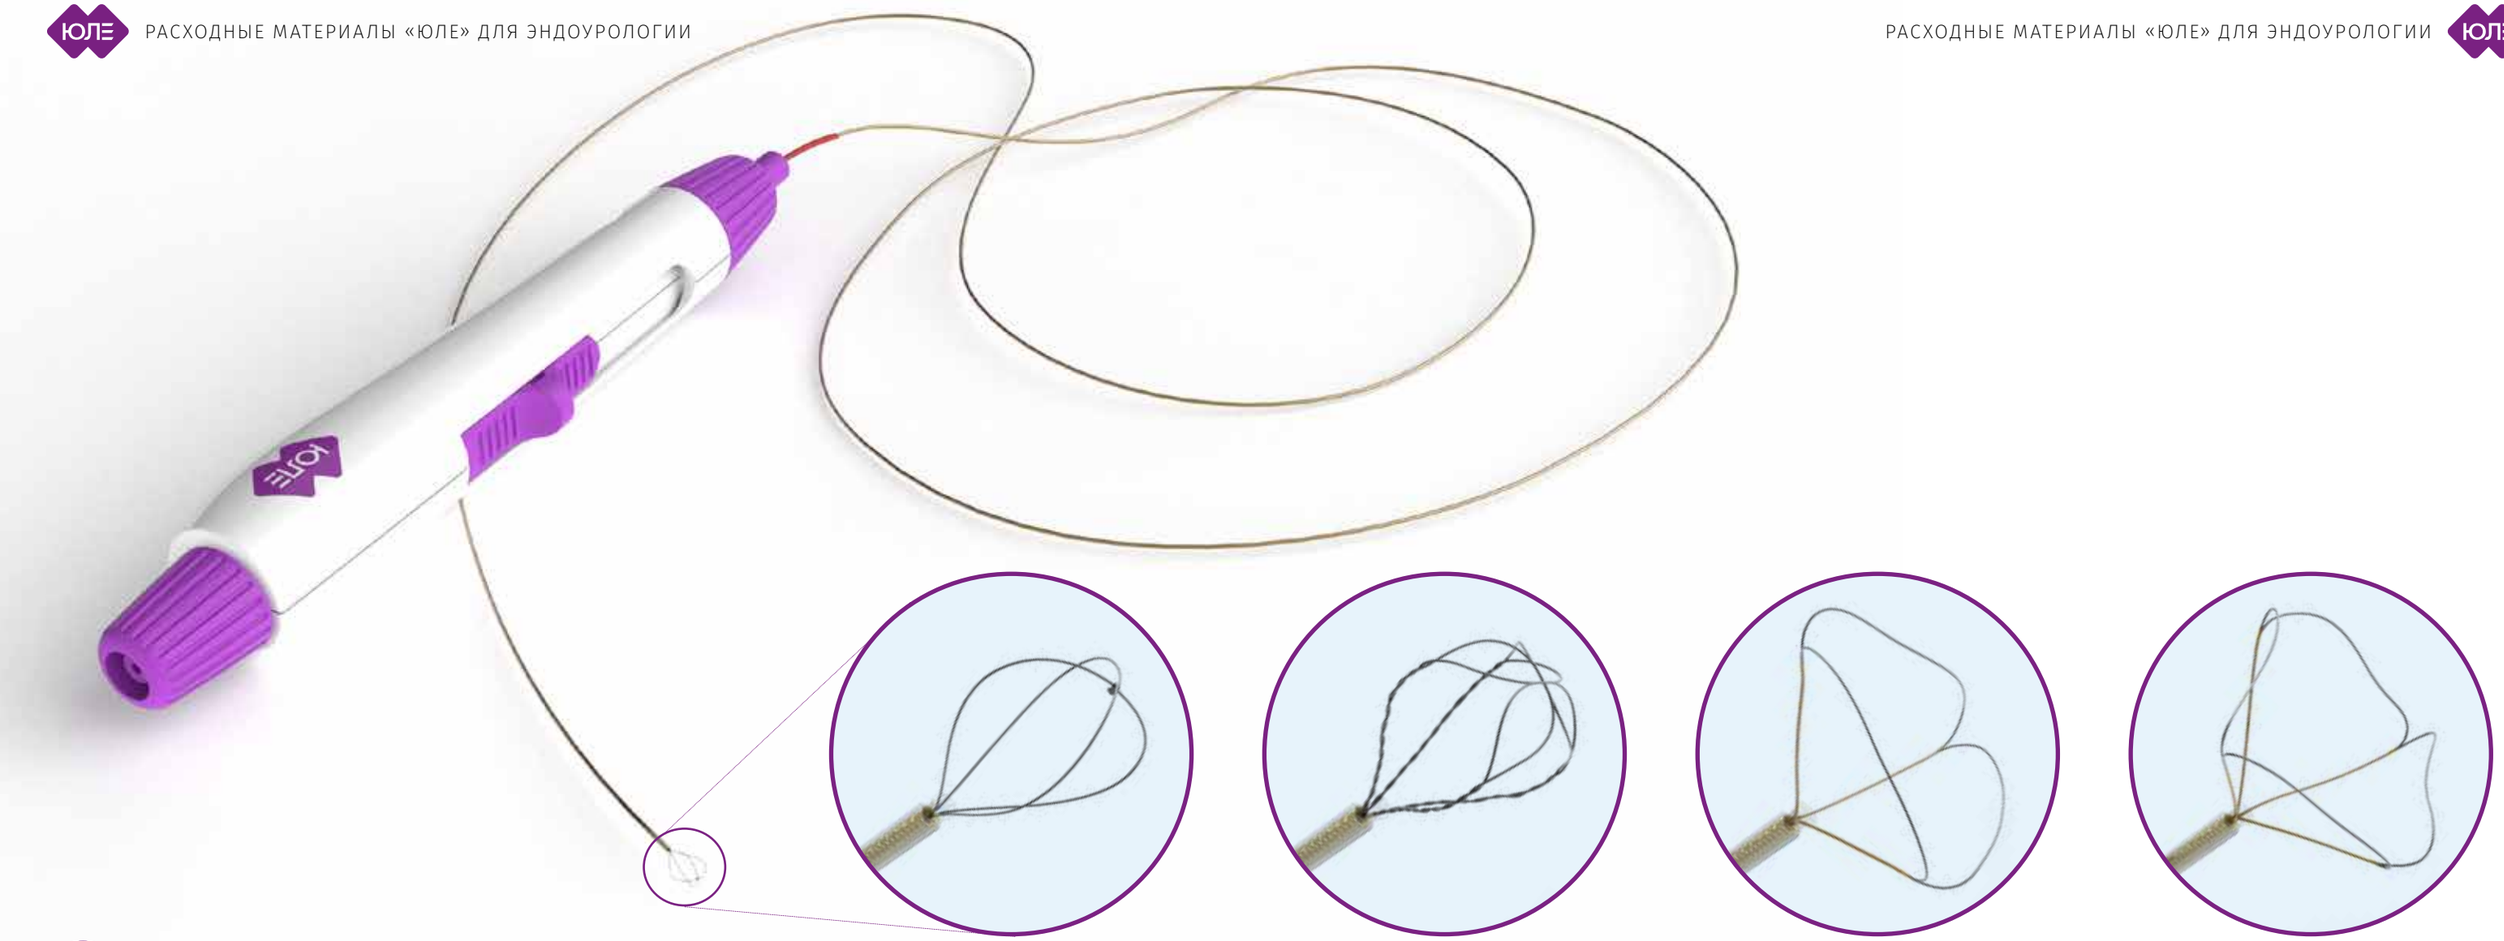

Модель **«Крес»**

Модель **«Сварга»**

Модель **«Гаруда»** *(3 ножки)*

Модель **«Гаруда»** *(4 ножки)*

Экстракторы камней ЮЛЕ

Литоэкстракторы ЮЛЕ предназначены для захвата и удаления камней во время любых эндоурологических процедур и выпускаются в четрех вариантах: для бокового захвата камня — модели **«Крес»** и **«Сварга»**, для торцевого — модель **«Гаруда»** (в модификациях с тремя или с четырьмя ножками корзинки).

Регистрационное удостоверение
РЗН 2021/14634 от 29.06.2021

Эргономичная рукоятка литоэкстракторов снабжена удобным механизмом управления корзинкой, позволяющим закрывать и открывать ее одним пальцем.

Рабочая часть (корзинка) всех литоэкстракторов выполена из **нитинола**, прочного металлического сплава, обладающего эффектом памяти формы.

Все экстракторы камней ЮЛЕ имеют **длину 115 см,** оптимально подходящую для применения во время любых эндоурологических вмешательств. Для моделей «Крес» и «Сварга» **можно выбрать гибкость кончика** (последние 15 см) катетера литоэкстрактора из трех возможных вариантов, в соответствии с вашими клиническими потребностями.

По одному экстрактору в упаковке

Срок годности **3 года**

Информация для заказа: Экстракторы камней ЮЛЕ

«Сварга»

		Размеры корзинки (длина × диаметр)		
		12 × 8 мм	**14 × 10 мм**	**20 × 16 мм**
стандартный кончик	**1,5 Fr**	ИНЭС1501ЮЛ		
	2,0 Fr	ИНЭС2001ЮЛ	ИНЭС2011ЮЛ	
	2,2 Fr		ИНЭС2211ЮЛ	ИНЭС2221ЮЛ
	2,6 Fr			ИНЭС2621ЮЛ
гибкий кончик	**1,5 Fr**	ИНЭС1502ЮЛ		
	2,0 Fr	ИНЭС2002ЮЛ	ИНЭС2012ЮЛ	
	2,2 Fr		ИНЭС2212ЮЛ	ИНЭС2222ЮЛ
	2,6 Fr			ИНЭС2622ЮЛ
средней гибкости кончик	**1,5 Fr**	ИНЭС1503ЮЛ		
	2,0 Fr	ИНЭС2003ЮЛ	ИНЭС2013ЮЛ	
	2,2 Fr		ИНЭС2213ЮЛ	ИНЭС2223ЮЛ
	2,6 Fr			ИНЭС2623ЮЛ

«Крес»

		Размеры корзинки (длина × диаметр)	
		15 × 10 мм	**25 × 20 мм**
стандартный кончик	**1,5 Fr**	ИНЭК1501ЮЛ	
	2,0 Fr	ИНЭК2001ЮЛ	
	2,6 Fr	ИНЭК2601ЮЛ	ИНЭК2611ЮЛ
гибкий кончик	**1,5 Fr**	ИНЭК1502ЮЛ	
	2,0 Fr	ИНЭК2002ЮЛ	
	2,6 Fr	ИНЭК2602ЮЛ	ИНЭК2612ЮЛ
средней гибкости кончик	**1,5 Fr**	ИНЭК1503ЮЛ	
	2,0 Fr	ИНЭК2003ЮЛ	
	2,6 Fr	ИНЭК2603ЮЛ	ИНЭК2613ЮЛ

«Гаруда»

		Размеры корзинки (длина × диаметр)	
		11 × 11 мм	**16 × 16 мм**
3 ножки	**1.7 Fr**	ИНЭГ1703ЮЛ	ИНЭГ1713ЮЛ
	2,2 Fr	ИНЭГ2203ЮЛ	ИНЭГ2213ЮЛ
4 ножки	**2,2 Fr**	ИНЭГ2204ЮЛ	ИНЭГ2214ЮЛ

Указатель артикулов

ИН3В5624ЮЛ 7
ИН3В5626ЮЛ 7
ИН3В5628ЮЛ 7
ИН3В5630ЮЛ 7
ИН3В5724ЮЛ 7
ИН3В5726ЮЛ 7
ИН3В5728ЮЛ 7
ИН3В5730ЮЛ 7
ИН3В5824ЮЛ 7
ИН3В5826ЮЛ 7
ИН3В5828ЮЛ 7
ИН3В5830ЮЛ 7
ИН3В7624ЮЛ 7
ИН3В7626ЮЛ 7
ИН3В7628ЮЛ 7
ИН3В7630ЮЛ 7
ИН3В7724ЮЛ 7
ИН3В7726ЮЛ 7
ИН3В7728ЮЛ 7
ИН3В7730ЮЛ 7
ИН3В7824ЮЛ 7
ИН3В7826ЮЛ 7
ИН3В7828ЮЛ 7
ИН3В7830ЮЛ 7
ИН3В9624ЮЛ 7
ИН3В9626ЮЛ 7
ИН3В9628ЮЛ 7
ИН3В9630ЮЛ 7
ИН3В9724ЮЛ 7
ИН3В9726ЮЛ 7
ИН3В9728ЮЛ 7
ИН3В9730ЮЛ 7
ИН3В9824ЮЛ 7
ИН3В9826ЮЛ 7
ИН3В9828ЮЛ 7
ИН3В9830ЮЛ 7
ИН3Д5624ЮЛ 7
ИН3Д5626ЮЛ 7
ИН3Д5628ЮЛ 7
ИН3Д5630ЮЛ 7
ИН3Д5724ЮЛ 7
ИН3Д5726ЮЛ 7
ИН3Д5728ЮЛ 7
ИН3Д5730ЮЛ 7
ИН3Д5824ЮЛ 7
ИН3Д5826ЮЛ 7
ИН3Д5828ЮЛ 7
ИН3Д5830ЮЛ 7
ИН3Д7624ЮЛ 7
ИН3Д7626ЮЛ 7
ИН3Д7628ЮЛ 7
ИН3Д7630ЮЛ 7
ИН3Д7724ЮЛ 7
ИН3Д7726ЮЛ 7
ИН3Д7728ЮЛ 7
ИН3Д7730ЮЛ 7
ИН3Д7824ЮЛ 7
ИН3Д7826ЮЛ 7
ИН3Д7828ЮЛ 7
ИН3Д7830ЮЛ 7
ИН3Д9624ЮЛ 7
ИН3Д9626ЮЛ 7
ИН3Д9628ЮЛ 7
ИН3Д9630ЮЛ 7
ИН3Д9724ЮЛ 7
ИН3Д9726ЮЛ 7
ИН3Д9728ЮЛ 7
ИН3Д9730ЮЛ 7
ИН3Д9824ЮЛ 7
ИН3Д9826ЮЛ 7
ИН3Д9828ЮЛ 7
ИН3Д9830ЮЛ 7
ИН3К5624ЮЛ 7
ИН3К5626ЮЛ 7
ИН3К5628ЮЛ 7
ИН3К5630ЮЛ 7
ИН3К5724ЮЛ 7
ИН3К5726ЮЛ 7
ИН3К5728ЮЛ 7
ИН3К5730ЮЛ 7
ИН3К5824ЮЛ 7
ИН3К5826ЮЛ 7
ИН3К5828ЮЛ 7
ИН3К5830ЮЛ 7
ИН3К7624ЮЛ 7
ИН3К7626ЮЛ 7
ИН3К7628ЮЛ 7
ИН3К7630ЮЛ 7
ИН3К7724ЮЛ 7
ИН3К7726ЮЛ 7
ИН3К7728ЮЛ 7
ИН3К7730ЮЛ 7
ИН3К7824ЮЛ 7
ИН3К7826ЮЛ 7
ИН3К7828ЮЛ 7
ИН3К7830ЮЛ 7
ИН3К9624ЮЛ 7
ИН3К9626ЮЛ 7
ИН3К9628ЮЛ 7
ИН3К9630ЮЛ 7
ИН3К9724ЮЛ 7
ИН3К9726ЮЛ 7
ИН3К9728ЮЛ 7
ИН3К9730ЮЛ 7
ИН3К9824ЮЛ 7
ИН3К9826ЮЛ 7
ИН3К9828ЮЛ 7
ИН3К9830ЮЛ 7
ИН3Л0624ЮЛ 7
ИН3Л0626ЮЛ 7
ИН3Л0628ЮЛ 7
ИН3Л0630ЮЛ 7
ИН3Л0724ЮЛ 7
ИН3Л0726ЮЛ 7
ИН3Л0728ЮЛ 7
ИН3Л0730ЮЛ 7
ИН3Л0824ЮЛ 7
ИН3Л0826ЮЛ 7
ИН3Л0828ЮЛ 7
ИН3Л0830ЮЛ 7
ИН3Л5612ЮЛ 8
ИН3Л5622ЮЛ 8
ИН3Л5624ЮЛ 7
ИН3Л5626ЮЛ 7
ИН3Л5628ЮЛ 7
ИН3Л5630ЮЛ 7
ИН3Л5712ЮЛ 8
ИН3Л5722ЮЛ 8
ИН3Л5724ЮЛ 7
ИН3Л5726ЮЛ 7
ИН3Л5728ЮЛ 7
ИН3Л5730ЮЛ 7
ИН3Л5824ЮЛ 7
ИН3Л5826ЮЛ 7
ИН3Л5828ЮЛ 7
ИН3Л5830ЮЛ 7
ИН3Л7624ЮЛ 7
ИН3Л7626ЮЛ 7
ИН3Л7628ЮЛ 7
ИН3Л7630ЮЛ 7
ИН3Л7724ЮЛ 7
ИН3Л7726ЮЛ 7
ИН3Л7728ЮЛ 7
ИН3Л7730ЮЛ 7
ИН3Л7824ЮЛ 7
ИН3Л7826ЮЛ 7
ИН3Л7828ЮЛ 7
ИН3Л7830ЮЛ 7
ИН3Л9624ЮЛ 7
ИН3Л9626ЮЛ 7
ИН3Л9628ЮЛ 7
ИН3Л9630ЮЛ 7
ИН3Л9724ЮЛ 7
ИН3Л9726ЮЛ 7
ИН3Л9728ЮЛ 7
ИН3Л9730ЮЛ 7
ИН3Л9824ЮЛ 7
ИН3Л9826ЮЛ 7
ИН3Л9828ЮЛ 7
ИН3Л9830ЮЛ 7
ИН3М5524ЮЛ 6
ИН3М5524ЮЛ-2 6
ИН3М5526ЮЛ 6
ИН3М5526ЮЛ-2 6
ИН3М5528ЮЛ 6
ИН3М5528ЮЛ-2 6
ИН3М5530ЮЛ 6
ИН3М5530ЮЛ-2 6
ИН3М5624ЮЛ 6
ИН3М5626ЮЛ 6
ИН3М5628ЮЛ 6
ИН3М5630ЮЛ 6
ИН3М5724ЮЛ 6
ИН3М5726ЮЛ 6
ИН3М5728ЮЛ 6
ИН3М5730ЮЛ 6
ИН3М7524ЮЛ 7
ИН3М7524ЮЛ-2 7
ИН3М7526ЮЛ 7
ИН3М7526ЮЛ-2 7
ИН3М7528ЮЛ 7
ИН3М7528ЮЛ-2 7
ИН3М7530ЮЛ 7
ИН3М7530ЮЛ-2 7
ИН3М7624ЮЛ 7
ИН3М7626ЮЛ 7
ИН3М7628ЮЛ 7
ИН3М7630ЮЛ 7
ИН3М7724ЮЛ 7
ИН3М7726ЮЛ 7
ИН3М7728ЮЛ 7
ИН3М7730ЮЛ 7
ИН3П7524ЮЛ 7
ИН3П7524ЮЛ-2 7
ИН3П7526ЮЛ 7
ИН3П7526ЮЛ-2 7
ИН3П7528ЮЛ 7
ИН3П7528ЮЛ-2 7
ИН3П7530ЮЛ 7
ИН3П7530ЮЛ-2 7
ИН3П7624ЮЛ 7
ИН3П7626ЮЛ 7
ИН3П7628ЮЛ 7
ИН3П7630ЮЛ 7
ИН3П7724ЮЛ 7
ИН3П7726ЮЛ 7
ИН3П7728ЮЛ 7
ИН3П7730ЮЛ 7
ИН3П9624ЮЛ 7
ИН3П9626ЮЛ 7
ИН3П9628ЮЛ 7
ИН3П9630ЮЛ 7
ИН3П9724ЮЛ 7
ИН3П9726ЮЛ 7
ИН3П9728ЮЛ 7
ИН3П9730ЮЛ 7
ИН3Р5524ЮЛ 6
ИН3Р5524ЮЛ-2 6
ИН3Р5526ЮЛ 6
ИН3Р5526ЮЛ-2 6
ИН3Р5528ЮЛ 6
ИН3Р5528ЮЛ-2 6
ИН3Р5530ЮЛ 6
ИН3Р5530ЮЛ-2 6
ИН3Р5624ЮЛ 6
ИН3Р5626ЮЛ 6
ИН3Р5628ЮЛ 6
ИН3Р5630ЮЛ 6
ИН3Р5724ЮЛ 6
ИН3Р5726ЮЛ 6
ИН3Р5728ЮЛ 6
ИН3Р5730ЮЛ 6
ИН3С0524ЮЛ 6
ИН3С0524ЮЛ-2 6
ИН3С0526ЮЛ 6
ИН3С0526ЮЛ-2 6
ИН3С0528ЮЛ 6
ИН3С0528ЮЛ-2 6
ИН3С0530ЮЛ 6
ИН3С0530ЮЛ-2 6
ИН3С0624ЮЛ 6
ИН3С0626ЮЛ 6
ИН3С0628ЮЛ 6
ИН3С0630ЮЛ 6
ИН3С0724ЮЛ 6
ИН3С0726ЮЛ 6
ИН3С0728ЮЛ 6
ИН3С0730ЮЛ 6
ИН3С5312ЮЛ 8
ИН3С5315ЮЛ 8
ИН3С5318ЮЛ 8
ИН3С5320ЮЛ 8
ИН3С5322ЮЛ 8
ИН3С5412ЮЛ 8
ИН3С5415ЮЛ 8
ИН3С5418ЮЛ 8
ИН3С5420ЮЛ 8
ИН3С5422ЮЛ 8
ИН3С5510ЮЛ 8
ИН3С5512ЮЛ 8
ИН3С5515ЮЛ 8
ИН3С5518ЮЛ 8
ИН3С5520ЮЛ 8
ИН3С5522ЮЛ 8
ИН3С5524ЮЛ 6
ИН3С5524ЮЛ-2 6
ИН3С5526ЮЛ 6
ИН3С5526ЮЛ-2 6
ИН3С5528ЮЛ 6
ИН3С5528ЮЛ-2 6
ИН3С5530ЮЛ 6
ИН3С5530ЮЛ-2 6
ИН3С5612ЮЛ 8
ИН3С5622ЮЛ 8
ИН3С5624ЮЛ 6
ИН3С5626ЮЛ 6
ИН3С5628ЮЛ 6
ИН3С5630ЮЛ 6
ИН3С5712ЮЛ 8
ИН3С5722ЮЛ 8
ИН3С5724ЮЛ 6
ИН3С5726ЮЛ 6
ИН3С5728ЮЛ 6
ИН3С5730ЮЛ 6
ИН3С7524ЮЛ 6
ИН3С7524ЮЛ-2 6
ИН3С7526ЮЛ 6
ИН3С7526ЮЛ-2 6
ИН3С7528ЮЛ 6
ИН3С7528ЮЛ-2 6
ИН3С7530ЮЛ 6
ИН3С7530ЮЛ-2 6
ИН3С7624ЮЛ 6
ИН3С7626ЮЛ 6
ИН3С7628ЮЛ 6
ИН3С7630ЮЛ 6
ИН3С7724ЮЛ 6
ИН3С7726ЮЛ 6
ИН3С7728ЮЛ 6
ИН3С7730ЮЛ 6
ИН3С9624ЮЛ 6
ИН3С9626ЮЛ 6
ИН3С9628ЮЛ 6
ИН3С9630ЮЛ 6
ИН3С9724ЮЛ 6
ИН3С9726ЮЛ 6
ИН3С9728ЮЛ 6
ИН3С9730ЮЛ 6
ИНКИ8110ЮЛ 9
ИНКИ8111ЮЛ 9
ИНКП4000ЮЛ 9
ИНКП4010ЮЛ 9
ИНКП4011ЮЛ 9
ИНКП4100ЮЛ 9
ИНКП4110ЮЛ 9
ИНКП4111ЮЛ 9
ИНКП5000ЮЛ 9
ИНКП5010ЮЛ 9
ИНКП5011ЮЛ 9
ИНКП5100ЮЛ 9
ИНКП5110ЮЛ 9
ИНКП5111ЮЛ 9
ИНКП6000ЮЛ 9
ИНКП6010ЮЛ 9
ИНКП6011ЮЛ 9
ИНКП6100ЮЛ 9
ИНКП6110ЮЛ 9
ИНКП6111ЮЛ 9
ИНКП7000ЮЛ 9
ИНКП7010ЮЛ 9
ИНКП7011ЮЛ 9
ИНКП7100ЮЛ 9
ИНКП7110ЮЛ 9
ИНКП7111ЮЛ 9
ИНКП8000ЮЛ 9
ИНКП8010ЮЛ 9
ИНКП8011ЮЛ 9
ИНКП8100ЮЛ 9
ИНКП8110ЮЛ 9
ИНКП8111ЮЛ 9
ИННМ0801ЮЛ 3
ИННМ0802ЮЛ 3
ИННМ0803ЮЛ 3
ИННМ0804ЮЛ 3
ИННМ0805ЮЛ 3
ИННМ0806ЮЛ 3
ИННМ0807ЮЛ 3
ИННМ0808ЮЛ 3
ИННМ1001ЮЛ 3
ИННМ1002ЮЛ 3
ИННМ1003ЮЛ 3
ИННМ1004ЮЛ 3
ИННМ1005ЮЛ 3
ИННМ1006ЮЛ 3
ИННМ1007ЮЛ 3
ИННМ1008ЮЛ 3
ИННМ1201ЮЛ 3
ИННМ1202ЮЛ 3
ИННМ1203ЮЛ 3
ИННМ1204ЮЛ 3
ИННМ1205ЮЛ 3
ИННМ1206ЮЛ 3
ИННМ1207ЮЛ 3
ИННМ1208ЮЛ 3
ИННМ1401ЮЛ 3
ИННМ1402ЮЛ 3
ИННМ1403ЮЛ 3
ИННМ1404ЮЛ 3
ИННМ1405ЮЛ 3
ИННП0801ЮЛ 3
ИННП0802ЮЛ 3
ИННП0803ЮЛ 3
ИННП0804ЮЛ 3
ИННП0805ЮЛ 3
ИННП0806ЮЛ 3
ИННП0807ЮЛ 3
ИННП0808ЮЛ 3
ИННП1001ЮЛ 3
ИННП1002ЮЛ 3
ИННП1003ЮЛ 3
ИННП1004ЮЛ 3
ИННП1005ЮЛ 3
ИННП1006ЮЛ 3
ИННП1007ЮЛ 3
ИННП1008ЮЛ 3
ИННП1201ЮЛ 3
ИННП1202ЮЛ 3
ИННП1203ЮЛ 3
ИННП1204ЮЛ 3
ИННП1205ЮЛ 3
ИННП1206ЮЛ 3
ИННП1207ЮЛ 3
ИННП1208ЮЛ 3
ИННП1401ЮЛ 3
ИННП1402ЮЛ 3
ИННП1403ЮЛ 3
ИННП1404ЮЛ 3
ИННП1405ЮЛ 3
ИНОВ5624ЮЛ 7
ИНОВ5626ЮЛ 7
ИНОВ5628ЮЛ 7
ИНОВ5630ЮЛ 7
ИНОВ5724ЮЛ 7
ИНОВ5726ЮЛ 7
ИНОВ5728ЮЛ 7
ИНОВ5730ЮЛ 7
ИНОВ5824ЮЛ 7
ИНОВ5826ЮЛ 7
ИНОВ5828ЮЛ 7
ИНОВ5830ЮЛ 7
ИНОВ7624ЮЛ 7
ИНОВ7626ЮЛ 7
ИНОВ7628ЮЛ 7
ИНОВ7630ЮЛ 7
ИНОВ7724ЮЛ 7
ИНОВ7726ЮЛ 7
ИНОВ7728ЮЛ 7
ИНОВ7730ЮЛ 7
ИНОВ7824ЮЛ 7
ИНОВ7826ЮЛ 7
ИНОВ7828ЮЛ 7
ИНОВ7830ЮЛ 7
ИНОВ9624ЮЛ 7
ИНОВ9626ЮЛ 7
ИНОВ9628ЮЛ 7
ИНОВ9630ЮЛ 7
ИНОВ9724ЮЛ 7
ИНОВ9726ЮЛ 7
ИНОВ9728ЮЛ 7
ИНОВ9730ЮЛ 7
ИНОВ9824ЮЛ 7
ИНОВ9826ЮЛ 7
ИНОВ9828ЮЛ 7
ИНОВ9830ЮЛ 7
ИНОД5624ЮЛ 7
ИНОД5626ЮЛ 7
ИНОД5628ЮЛ 7
ИНОД5630ЮЛ 7
ИНОД5724ЮЛ 7
ИНОД5726ЮЛ 7
ИНОД5728ЮЛ 7
ИНОД5730ЮЛ 7
ИНОД5824ЮЛ 7
ИНОД5826ЮЛ 7
ИНОД5828ЮЛ 7
ИНОД5830ЮЛ 7
ИНОД7624ЮЛ 7
ИНОД7626ЮЛ 7
ИНОД7628ЮЛ 7
ИНОД7630ЮЛ 7
ИНОД7724ЮЛ 7
ИНОД7726ЮЛ 7
ИНОД7728ЮЛ 7
ИНОД7730ЮЛ 7
ИНОД7824ЮЛ 7
ИНОД7826ЮЛ 7
ИНОД7828ЮЛ 7
ИНОД7830ЮЛ 7
ИНОД9624ЮЛ 7
ИНОД9626ЮЛ 7
ИНОД9628ЮЛ 7
ИНОД9630ЮЛ 7
ИНОД9724ЮЛ 7
ИНОД9726ЮЛ 7
ИНОД9728ЮЛ 7
ИНОД9730ЮЛ 7
ИНОД9824ЮЛ 7
ИНОД9826ЮЛ 7
ИНОД9828ЮЛ 7
ИНОД9830ЮЛ 7
ИНОК5624ЮЛ 7
ИНОК5626ЮЛ 7
ИНОК5628ЮЛ 7
ИНОК5630ЮЛ 7
ИНОК5724ЮЛ 7
ИНОК5726ЮЛ 7
ИНОК5728ЮЛ 7
ИНОК5730ЮЛ 7
ИНОК5824ЮЛ 7
ИНОК5826ЮЛ 7
ИНОК5828ЮЛ 7
ИНОК5830ЮЛ 7
ИНОК7624ЮЛ 7
ИНОК7626ЮЛ 7
ИНОК7628ЮЛ 7
ИНОК7630ЮЛ 7
ИНОК7724ЮЛ 7
ИНОК7726ЮЛ 7
ИНОК7728ЮЛ 7
ИНОК7730ЮЛ 7
ИНОК7824ЮЛ 7
ИНОК7826ЮЛ 7
ИНОК7828ЮЛ 7
ИНОК7830ЮЛ 7
ИНОК9624ЮЛ 7
ИНОК9626ЮЛ 7
ИНОК9628ЮЛ 7
ИНОК9630ЮЛ 7
ИНОК9724ЮЛ 7
ИНОК9726ЮЛ 7
ИНОК9728ЮЛ 7
ИНОК9730ЮЛ 7
ИНОК9824ЮЛ 7
ИНОК9826ЮЛ 7
ИНОК9828ЮЛ 7
ИНОК9830ЮЛ 7
ИНОЛ0624ЮЛ 7
ИНОЛ0626ЮЛ 7
ИНОЛ0628ЮЛ 7
ИНОЛ0630ЮЛ 7
ИНОЛ0724ЮЛ 7
ИНОЛ0726ЮЛ 7
ИНОЛ0728ЮЛ 7
ИНОЛ0730ЮЛ 7
ИНОЛ0824ЮЛ 7
ИНОЛ0826ЮЛ 7
ИНОЛ0828ЮЛ 7
ИНОЛ0830ЮЛ 7
ИНОЛ5612ЮЛ 8
ИНОЛ5622ЮЛ 8
ИНОЛ5624ЮЛ 7
ИНОЛ5626ЮЛ 7
ИНОЛ5628ЮЛ 7
ИНОЛ5630ЮЛ 7
ИНОЛ5712ЮЛ 8
ИНОЛ5722ЮЛ 8
ИНОЛ5724ЮЛ 7
ИНОЛ5726ЮЛ 7
ИНОЛ5728ЮЛ 7
ИНОЛ5730ЮЛ 7
ИНОЛ5824ЮЛ 7
ИНОЛ5826ЮЛ 7
ИНОЛ5828ЮЛ 7
ИНОЛ5830ЮЛ 7
ИНОЛ7624ЮЛ 7
ИНОЛ7626ЮЛ 7
ИНОЛ7628ЮЛ 7
ИНОЛ7630ЮЛ 7
ИНОЛ7724ЮЛ 7
ИНОЛ7726ЮЛ 7
ИНОЛ7728ЮЛ 7
ИНОЛ7730ЮЛ 7
ИНОЛ7824ЮЛ 7
ИНОЛ7826ЮЛ 7
ИНОЛ7828ЮЛ 7
ИНОЛ7830ЮЛ 7
ИНОЛ9624ЮЛ 7
ИНОЛ9626ЮЛ 7
ИНОЛ9628ЮЛ 7
ИНОЛ9630ЮЛ 7
ИНОЛ9724ЮЛ 7
ИНОЛ9726ЮЛ 7
ИНОЛ9728ЮЛ 7
ИНОЛ9730ЮЛ 7
ИНОЛ9824ЮЛ 7
ИНОЛ9826ЮЛ 7
ИНОЛ9828ЮЛ 7
ИНОЛ9830ЮЛ 7
ИНОМ5524ЮЛ 6
ИНОМ5524ЮЛ-2 6
ИНОМ5526ЮЛ 6
ИНОМ5526ЮЛ-2 6
ИНОМ5528ЮЛ 6
ИНОМ5528ЮЛ-2 6
ИНОМ5530ЮЛ 6
ИНОМ5530ЮЛ-2 6
ИНОМ5624ЮЛ 6
ИНОМ5626ЮЛ 6
ИНОМ5628ЮЛ 6
ИНОМ5630ЮЛ 6
ИНОМ5724ЮЛ 6
ИНОМ5726ЮЛ 6
ИНОМ5728ЮЛ 6
ИНОМ5730ЮЛ 6
ИНОМ7524ЮЛ 6
ИНОМ7524ЮЛ-2 6
ИНОМ7526ЮЛ 6
ИНОМ7526ЮЛ-2 6
ИНОМ7528ЮЛ 6
ИНОМ7528ЮЛ-2 6
ИНОМ7530ЮЛ 6
ИНОМ7530ЮЛ-2 6
ИНОМ7624ЮЛ 6
ИНОМ7626ЮЛ 6
ИНОМ7628ЮЛ 6
ИНОМ7630ЮЛ 6
ИНОМ7724ЮЛ 6
ИНОМ7726ЮЛ 6
ИНОМ7728ЮЛ 6
ИНОМ7730ЮЛ 6
ИНОМ9624ЮЛ 6
ИНОМ9626ЮЛ 6
ИНОМ9628ЮЛ 6
ИНОМ9630ЮЛ 6
ИНОМ9724ЮЛ 6
ИНОМ9726ЮЛ 6
ИНОМ9728ЮЛ 6
ИНОМ9730ЮЛ 6
ИНОП5524ЮЛ 6
ИНОП5524ЮЛ-2 6
ИНОП5526ЮЛ 6
ИНОП5526ЮЛ-2 6
ИНОП5528ЮЛ 6
ИНОП5528ЮЛ-2 6
ИНОП5530ЮЛ 6
ИНОП5530ЮЛ-2 6
ИНОП5624ЮЛ 6
ИНОП5626ЮЛ 6
ИНОП5628ЮЛ 6
ИНОП5724ЮЛ 6
ИНОП5726ЮЛ 6
ИНОП5728ЮЛ 6
ИНОП5730ЮЛ 6
ИНОП7524ЮЛ 6
ИНОП7524ЮЛ-2 6
ИНОП7526ЮЛ 6
ИНОП7526ЮЛ-2 6
ИНОП7528ЮЛ 6
ИНОП7528ЮЛ* 6
ИНОП7530ЮЛ 6
ИНОП7530ЮЛ-2 6
ИНОП7624ЮЛ 6
ИНОП7626ЮЛ 6
ИНОП7628ЮЛ 6
ИНОП7630ЮЛ 6
ИНОП7724ЮЛ 6
ИНОП7726ЮЛ 6
ИНОП7728ЮЛ 6
ИНОП7730ЮЛ 6
ИНОП9624ЮЛ 6
ИНОП9626ЮЛ 6
ИНОП9628ЮЛ 6
ИНОП9630ЮЛ 6
ИНОП9724ЮЛ 6
ИНОП9726ЮЛ 6
ИНОП9728ЮЛ 6
ИНОП9730ЮЛ 6
ИНОР5524ЮЛ 6
ИНОР5524ЮЛ-2 6
ИНОР5526ЮЛ 6
ИНОР5526ЮЛ-2 6
ИНОР5528ЮЛ 6
ИНОР5528ЮЛ-2 6
ИНОР5530ЮЛ 6
ИНОР5530ЮЛ-2 6
ИНОР5624ЮЛ 6
ИНОР5626ЮЛ 6
ИНОР5628ЮЛ 6
ИНОР5630ЮЛ 6
ИНОР5724ЮЛ 6
ИНОР5726ЮЛ 6
ИНОР5728ЮЛ 6
ИНОР5730ЮЛ 6
ИНОР7524ЮЛ 6
ИНОР7524ЮЛ-2 6
ИНОР7526ЮЛ 6
ИНОР7526ЮЛ-2 6
ИНОР7528ЮЛ 6
ИНОР7528ЮЛ-2 6
ИНОР7530ЮЛ 6
ИНОР7530ЮЛ-2 6
ИНОР7624ЮЛ 6
ИНОР7626ЮЛ 6
ИНОР7628ЮЛ 6
ИНОР7630ЮЛ 6
ИНОР7724ЮЛ 6
ИНОР7726ЮЛ 6
ИНОР7728ЮЛ 6
ИНОР7730ЮЛ 6
ИНОР9624ЮЛ 6
ИНОР9626ЮЛ 6
ИНОР9628ЮЛ 6
ИНОР9630ЮЛ 6
ИНОР9724ЮЛ 6
ИНОР9726ЮЛ 6
ИНОР9728ЮЛ 6
ИНОР9730ЮЛ 6
ИНОС0524ЮЛ 6
ИНОС0524ЮЛ-2 6
ИНОС0526ЮЛ 6
ИНОС0526ЮЛ-2 6
ИНОС0528ЮЛ 6
ИНОС0528ЮЛ-2 6
ИНОС0530ЮЛ 6
ИНОС0530ЮЛ-2 6
ИНОС0624ЮЛ 6
ИНОС0626ЮЛ 6
ИНОС0628ЮЛ 6
ИНОС0630ЮЛ 6
ИНОС0724ЮЛ 6
ИНОС0726ЮЛ 6
ИНОС0728ЮЛ 6
ИНОС0730ЮЛ 6
ИНОС5312ЮЛ 8
ИНОС5315ЮЛ 8
ИНОС5318ЮЛ 8
ИНОС5320ЮЛ 8
ИНОС5322ЮЛ 8
ИНОС5412ЮЛ 8
ИНОС5415ЮЛ 8
ИНОС5418ЮЛ 8
ИНОС5420ЮЛ 8
ИНОС5422ЮЛ 8
ИНОС5510ЮЛ 8
ИНОС5512ЮЛ 8
ИНОС5515ЮЛ 8
ИНОС5518ЮЛ 8
ИНОС5520ЮЛ 8
ИНОС5522ЮЛ 8
ИНОС5524ЮЛ 6
ИНОС5524ЮЛ-2 6
ИНОС5526ЮЛ 6
ИНОС5526ЮЛ-2 6
ИНОС5528ЮЛ 6
ИНОС5528ЮЛ-2 6
ИНОС5530ЮЛ 6
ИНОС5530ЮЛ-2 6
ИНОС5612ЮЛ 8
ИНОС5624ЮЛ 6
ИНОС5626ЮЛ 6
ИНОС5628ЮЛ 6
ИНОС5630ЮЛ 6
ИНОС5724ЮЛ 6
ИНОС5726ЮЛ 6
ИНОС5728ЮЛ 6
ИНОС5730ЮЛ 6
ИНОС7524ЮЛ 6
ИНОС7524ЮЛ-2 6
ИНОС7526ЮЛ 6
ИНОС7526ЮЛ-2 6
ИНОС7528ЮЛ 6
ИНОС7528ЮЛ-2 6
ИНОС7530ЮЛ 6
ИНОС7530ЮЛ-2 6
ИНОС7624ЮЛ 6
ИНОС7626ЮЛ 6
ИНОС7628ЮЛ 6
ИНОС7630ЮЛ 6
ИНОС7724ЮЛ 6
ИНОС7726ЮЛ 6
ИНОС7728ЮЛ 6
ИНОС7730ЮЛ 6
ИНОС9624ЮЛ 6
ИНОС9626ЮЛ 6
ИНОС9628ЮЛ 6
ИНОС9630ЮЛ 6
ИНОС9724ЮЛ 6
ИНОС9726ЮЛ 6
ИНОС9728ЮЛ 6
ИНОС9730ЮЛ 6
ИНСБ3630ЮЛ 8
ИНСБ3632ЮЛ 8
ИНСБ3730ЮЛ 8
ИНСБ3732ЮЛ 8
ИНСБ5530ЮЛ 8
ИНСБ5532ЮЛ 8
ИНСБ5630ЮЛ 8
ИНСБ5632ЮЛ 8
ИНСБ5730ЮЛ 8
ИНСБ5732ЮЛ 8
ИНСБ7530ЮЛ 8
ИНСБ7532ЮЛ 8
ИНСБ7630ЮЛ 8
ИНСБ7632ЮЛ 8
ИНСБ7730ЮЛ 8
ИНСБ7732ЮЛ 8
ИНСБ9630ЮЛ 8
ИНСБ9632ЮЛ 8
ИНСБ9730ЮЛ 8
ИНСБ9732ЮЛ 8
ИНСВ3630ЮЛ 8
ИНСВ3632ЮЛ 8
ИНСВ3730ЮЛ 8
ИНСВ3732ЮЛ 8
ИНСВ5530ЮЛ 8
ИНСВ5532ЮЛ 8
ИНСВ5630ЮЛ 8
ИНСВ5632ЮЛ 8
ИНСВ5730ЮЛ 8
ИНСВ5732ЮЛ 8
ИНСВ7530ЮЛ 8
ИНСВ7532ЮЛ 8
ИНСВ7630ЮЛ 8
ИНСВ7632ЮЛ 8
ИНСВ7730ЮЛ 8
ИНСВ7732ЮЛ 8
ИНСВ9630ЮЛ 8
ИНСВ9632ЮЛ 8
ИНСВ9730ЮЛ 8
ИНСВ9732ЮЛ 8
ИНСД5690ЮЛ 8
ИНСД5790ЮЛ 8
ИНСД5890ЮЛ 8
ИНСД7690ЮЛ 8
ИНСД7790ЮЛ 8
ИНСД7890ЮЛ 8
ИНСК5690ЮЛ 8
ИНСК5790ЮЛ 8
ИНСК5890ЮЛ 8
ИНСК7690ЮЛ 8
ИНСК7790ЮЛ 8
ИНСК7890ЮЛ 8
ИНСЛ5690ЮЛ 8
ИНСЛ5790ЮЛ 8
ИНСЛ7690ЮЛ 8
ИНСЛ7790ЮЛ 8
ИНСР5690ЮЛ 8
ИНСР5790ЮЛ 8
ИНСР7690ЮЛ 8
ИНСР7790ЮЛ 8
ИНЭГ1703ЮЛ 11
ИНЭГ1713ЮЛ 11
ИНЭГ2203ЮЛ 11
ИНЭГ2204ЮЛ 11
ИНЭГ2213ЮЛ 11
ИНЭГ2214ЮЛ 11
ИНЭК1501ЮЛ 11
ИНЭК1502ЮЛ 11
ИНЭК1503ЮЛ 11
ИНЭК2001ЮЛ 11
ИНЭК2002ЮЛ 11
ИНЭК2003ЮЛ 11
ИНЭК2601ЮЛ 11
ИНЭК2602ЮЛ 11
ИНЭК2603ЮЛ 11
ИНЭК2611ЮЛ 11
ИНЭК2612ЮЛ 11
ИНЭК2613ЮЛ 11
ИНЭС1501ЮЛ 11
ИНЭС1502ЮЛ 11
ИНЭС1503ЮЛ 11
ИНЭС2001ЮЛ 11
ИНЭС2002ЮЛ 11
ИНЭС2003ЮЛ 11
ИНЭС2011ЮЛ 11
ИНЭС2012ЮЛ 11
ИНЭС2013ЮЛ 11
ИНЭС2211ЮЛ 11
ИНЭС2212ЮЛ 11
ИНЭС2213ЮЛ 11
ИНЭС2221ЮЛ 11
ИНЭС2222ЮЛ 11
ИНЭС2223ЮЛ 11
ИНЭС2621ЮЛ 11
ИНЭС2622ЮЛ 11
ИНЭС2623ЮЛ 11

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ЮЛЕ» ДЛЯ ЭНДОУРОЛОГИИ

ООО «ИНКОРО» (бренд ЮЛЕ) — российский производитель расходных материалов для эндоурологии

Начав в 2017 году с локализации в РФ производства французской компании Rocamed, специалисты ООО «ИНКОРО» на сегодняшний день собрали огромный практический опыт, чтобы перейти на самостоятельное производство эндоурологической продукции на собственных мощностях на территории особой экономической зоны «Технополис Москва»

Благодаря накопленному опыту, высочайшим стандартам, европейским процедурам технического контроля и использованию исключительно качественного сырья, продукты, выпускаемые под брендом ЮЛЕ, по праву пользуются заслуженным уважением врачей-урологов по всей России.

ЗАО «СЭЙДЖ» — официальный представитель ЮЛЕ в Российской Федерации

СЭЙДЖ

ОСНОВАНО В 1995

Центральный офис
121069 Москва
ул. Малая Никитская, д. 20/9, стр. 2
+7 (495) 234 3945, +7 (495) 234 3946
+7 (495) 690 2664, +7 (495) 690 2501
+7 (495) 690 2815
Факс: +7 (495) 234-39-47
E-mail: info@sagemed.ru

Урал
620137 Екатеринбург
ул. Мира, д. 8, офис 106
Телефон/факс: +7 (343) 286 1977
Телефон моб.: +7 (912) 607 9691
E-mail: pavlova@sagemed.ru

Сибирь
630001 Новосибирск,
ул. Кавалерийская, д. 2, офис 12
Телефон/факс: +7 (383) 311 0073
Телефон моб.: +7 (983) 321 4700
E-mail: sage-sibir@sagemed.ru

Южный регион
350063 Краснодар
Кубанская наб., д. 45, офис 501
Телефон: +7 (861) 238 6112
Телефон моб.: +7 (989) 127 0243
E-mail: sage-kuban@sagemed.ru

Поволжье
603005 Нижний Новгород
ул. Мануфактурная, 14, оф. 204
Телефон/факс: +7 (831) 411 9456
Телефон моб.: +7 (989) 127 0243
E-mail: sage-volga@sagemed.ru

Северо-запад
191119 Санкт-Петербург
ул. Социалистическая, 14, лит. А, оф.508
Телефон/факс: +7 (812) 607 5998
Телефон моб.: +7 (911) 923 4691
E-mail: sage-spb@sagemed.ru

© 2022 ЗАО «Сэйдж»

Представленные в брошюре продукты имеют противопоказания к использованию и должны применяться только по назначению и под контролем квалифицированного медицинского персонала.

Материалы, представленные в настоящей брошюре, верны на момент печати (сентябрь 2022), носят информативный характер и не являются руководством к клиническому применению описываемых продуктов. Для получения информации, касающейся непосредственно показаний, противопоказаний и непредвиденных побочных явлений, возникающих в связи с использованием описываемых продуктов, обратитесь к соответствующим инструкциям от производителя.

Дизайн alex@tolmasoff.ru.

Все приведенные в настоящей брошюре зарегистрированные торговые знаки и товарные марки принадлежат их законным правообладателям.

Мы в интернете
www.sagemed.ru